



AUTOMATIC BLOOD PRESSURE MONITOR

MODEL M-200A
USER'S MANUAL



dr-frei.com

- (EN) AUTOMATIC BLOOD PRESSURE MONITOR**
Model M-200A
User's manual (4-19)
- (RU) АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ**
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ТМ DR.FREI
Модель М-200А
Руководство по эксплуатации (20-37)
- (LT) AUTOMATINIS ARTERINIO**
KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIS
Modelis M-200A
Vartotojo instrukcija (38-54)
- (LV) AUTOMĀTISKS ARTERIĀLĀ**
SPIEDIENA MĒRĪTĀJS
Modelis M-200A
Lietotāja instrukcija (55-71)
- (RO) TENSIOMETRU AUTOMAT NON-INVAZIV**
(MD) Model M-200A
Manual de utilizare (72-88)
- (KZ) АРТЕРИЯЛЫҚ ҚЫСЫМДЫ АВТОМАТТЫ ӨЛШЕГІШ**
TM DR.FREI
модель М-200А
Қолданушы ережелері (89-106)
- (BG) АВТОМАТИЧЕН АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО**
НАЛЯГАНЕ ЗА ГОРНАТА ЧАСТ НА РЪКАТА
Модел M-200A
Инструкция за употреба (107-124)

DEAR DR. FREI AUTOMATIC BLOOD PRESSURE MONITOR OWNER

Thank you for choosing Automatic Blood Pressure Monitor **Dr. Frei® TM** model M-200A. We are sure that having appraised worthily the high quality and reliability of this device you will become a regular user of the products of Swiss Trademark **Dr. Frei®**.

Before starting to use this device please study the user's manual carefully. The user's manual offers all information you need to measure your blood pressure and pulse correctly. For all questions concerning the device please contact your local distributor or **Dr. Frei®** service centre in your country.

ATTENTION

This blood pressure monitor is designed to carry out self-control over blood pressure but NOT to make self-diagnosis of hypertension/hypotension. Please DO NOT diagnose by yourselves basing on the measurement results obtained with the blood pressure monitor. Please DO NOT execute self-treatment of high/low blood pressure and DO NOT change the methods prescribed without consulting your doctor.



Type BF applied part.



Read the instructions carefully before using this device.


TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT INFORMATION ON BLOOD PRESSURE AND ITS MEASUREMENT	6
What Is Blood Pressure?	6
Which Values Are Normal?	7
ADVANTAGES OF AUTOMATIC BLOODPRESSURE MONITOR MODEL M-200A.....	8
Blood Pressure Rate Indicator.....	8
Irregular Heartbeat Detector.....	8
GETTING READY FOR MEASUREMENT	9
Safety Precautions	9
Components of Blood Pressure Monitor Kit	9
Description of the Blood Pressure Monitor	10
Inserting the Batteries.....	10
Setting the Time and Date	11
Selecting the User	11
Using an A/C Power Adapter	11
Cuff Connection.....	12
MEASUREMENT PROCEDURE.....	12
Fitting the Cuff	13
Measuring Procedure	13
Reading Measurement Result	14
Discontinuing a Measurement	14
MEMORY FUNCTION	14
Viewing the Stored Values	14
Delete Memories	15
ERROR MESSAGES/TROUBLESHOOTING	15
CARE AND MAINTENANCE.....	17
SYMBOL INFORMATION	18
TECHNICAL SPECIFICATIONS	18
WARRANTY	19

IMPORTANT INFORMATION ON BLOOD PRESSURE AND ITS MEASUREMENT


What Is Blood Pressure?

Blood pressure is the pressure that your blood extends to the vascular walls. Blood pressure is necessary to provide for constant blood flow inside the body. Thanks to it the cells get oxygen that provides for their normal functioning. The heart performs the function of a «pump», sending blood to the blood vessels. Each heart beat creates a certain level of the blood pressure.

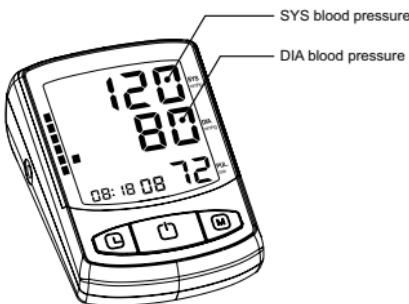

There are 2 kinds of blood pressure: a systolic (upper) one, which corresponds to the heartbeat pushing blood into the arteriae; and a diastolic (lower) one, which means the blood pressure between two heartbeats. Blood pressure is subject to fluctuations during the day even in healthy people. The fluctuations are influenced by a number of factors - time of day, person's condition, physical or mental activity, environment, etc.

Day-Night Fluctuations of the Blood Pressure

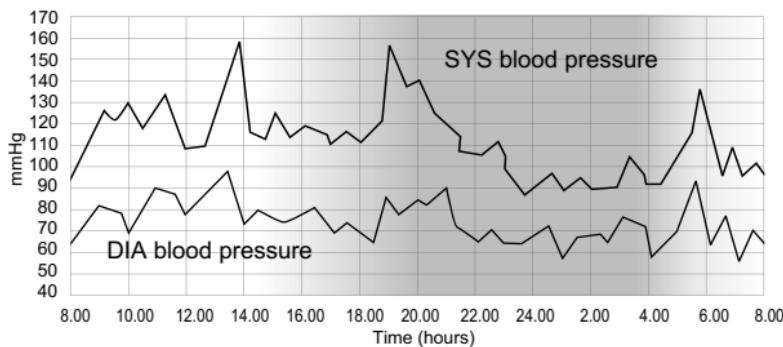

An increase of blood pressure increases the burden onto the heart, affects blood vessels making their walls thick and less elastic.

One of the features of the hypertension is its ability to remain unnoticed for the patient at its early stages. That's why the self-control of the blood pressure is so important. With the illness progressing, headaches and regular dizziness appear, the sight declines, the functioning of vitalises (encephalon, heart, kidneys, blood vessels) breaks down. Without special treatment the complications of hypertension might be kidney damages, breast-pang, paralytic stroke, aphasia, dementia, heart attack and stroke.

Which Values are Normal?

The world standard as for the norms of the blood pressure is the Classification* of the World Health Organization (WHO):

Category	Systolic Blood Pressure (mmHg)	Diastolic Blood Pressure (mmHg)
Blood pressure too low	< 100	< 60
Blood pressure optimum	100 - 119	60 - 79
Blood pressure normal	120 - 129	80 - 84
Blood pressure slightly high	130 - 139	85 - 89
Blood pressure too high	140 - 159	90 - 99
Blood pressure far too high	160 - 179	100 - 109
Blood pressure dangerously high	≥ 180	≥ 110

* printed with curtailments

- The diagnosis of hypertension requires from the patient to combine medical treatment prescribed by the doctor and mode of life correction.
- People with normal pressure and high normal pressure are recommended to carry out self-control of their tension in order to timely take measures to decrease the blood pressure level down to the optimal one without using any medications.
- For people more than 50 years old high level of systolic blood pressure (higher than 140 mmHg) is more crucial than diastolic pressure.
- Even with blood pressure being normal, people run the bigger risk of hypertension development with advancing age.

ATTENTION

If you have normal results of blood pressure measured under calm conditions but your results are excessively high when measured under the conditions of physical or mental exhaustion, this might be a sign of so called brittle (that is unstable) hypertension. If you suspect that, please consult your doctor.

When measured correctly, if diastolic blood pressure is more than 120 mmHg, it is necessary to call the doctor immediately.

ADVANTAGES OF AUTOMATIC BLOOD PRESSURE MONITOR MODEL M-200A

Blood Pressure Rate Indicator

Blood pressure rate indicator is located along left side of the display. The classification corresponds to 6 ranges described in the table of the section «Which values are normal?». After the measurement there appears the dotted line in the left part of the display opposite the zone to which the result of the measurement corresponds: green zone - optimal blood pressure, yellow - elevated, orange - too high, red - dangerously high. This function helps you to self-orient in the measurement results.

Irregular Heartbeat Detector

This technology indicates allorhythmic heartbeating. If the symbol of IHB  appears on the display that means that certain abnormality in heart beat frequency was detected during the measurement.

In this case, the result may deviate from your normal blood pressure - repeat the measurement. In most cases, this is no cause for concern. However, if the symbol  appears on a regular basis (e.g. several times a week with measurements taken daily) we advise you to tell your doctor. Please show your doctor the following explanation:

Information for the doctor on frequent appearance of the Irregular Heartbeat Detector.

This instrument is an oscillometric blood pressure monitor that also analyses pulse frequency during measurement.

The symbol  is displayed after the measurement, if pulse irregularities occur during measurement. If the symbol  appears more frequently (e.g. several times per week on measurements performed daily) we recommend the patient to seek medical advice. The instrument does not replace a cardiac examination, but serves to detect pulse irregularities at an early stage.

GETTING READY FOR MEASUREMENT

Safety Precautions

1. Use this device ONLY for the intended use described in this manual.
2. Do NOT use accessories which are not specified by the manufacturer.
3. Do NOT use the device if it is not working properly or damaged.
4. Do NOT use the equipment where aerosol sprays are being used, or where oxygen is being administered.
5. Do NOT use under any circumstances on newborns.
6. This device does NOT serve as a cure for any symptoms or diseases. The data measured are for reference only. Always consult your doctor to have the results interpreted.
7. Keep the equipment and its flexible cord away from hot surfaces.
8. Do NOT apply the cuff to areas other than the place directed.
9. Proper maintenance and periodically calibration are essential to the longevity of your device. If you are concerned about your accuracy of measurement, please contact local customer service for help.
10. This system is intended for individuals age 18 or above.
11. Do not use it for diagnosis of hypertension or testing on newborns, babies, young children or persons who cannot express their consent.
12. If you have been diagnosed with arrhythmia or irregular heartbeat, atrial or ventricular premature beats or atrial fibrillation, measurements made with this instrument should only be evaluated after consultation with the doctor or your healthcare professionals.


KEEP THIS MANUAL DURING THE WHOLE LIFETIME OF THE DEVICE

Components of Your Blood Pressure Monitor Kit

The blood pressure monitor kit includes Automatic Blood Pressure Monitor model M-200A, 22-42 cm cuff, 4 batteries (AA), user's manual, adapter, warranty card, kit box.

Description of the Blood Pressure Monitor

Measuring unit Model M-200A

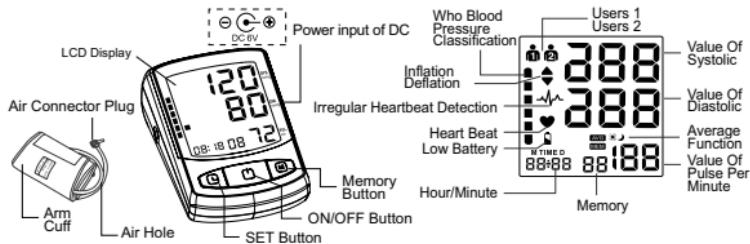


Accessory:



* Please use the original adapter in accessory, otherwise it is impossible to achieve the claimed performance.

Inserting the Batteries

1. Remove the battery cover.
2. Insert new batteries into the battery compartment as shown, taking care
3. that the polarities (+) and (-) are correct. Close the battery cover. Use only LR6, AA batteries.



CAUTION


- Insert the batteries as shown in the battery compartment.
- When  blinks in the display, replace all batteries with new ones. Do not mix old and new batteries. It may shorten the battery life, or cause the device to malfunction.
-  does not appear when the batteries run out.
- Battery life varies with the ambient temperature and may be shorter at low temperatures.
- Remove the batteries if the device is not to be used for a long time.
- The batteries may leak and cause a malfunction.
- Use the specified batteries only. The batteries provided with the device are for testing monitor performance and may have a shorter life.

NOTE: To prolong the batteries life the device switches off automatically if no button is pressed for 1 minute. Otherwise you can switch it off by pressing the ON/OFF button.

Setting the Time and Date

This blood pressure monitor incorporates the function of time and date display. Time and date are recorded along with pressure and pulse.

1. Press the «» button to switch on the monitor.
2. Press and hold «» button until the year number displays and flashes on LCD to enter setting mode.
3. Press «M» to adjust the year. Confirm your selection by pressing «» button.
4. Following the same steps to choose month, date, hour, minutes.



Select the User

This blood pressure monitor is designed to store 30 measurements for each of two users. Before taking a measurement, be certain that the correct user has been selected.

1. With the unit off, press «SET» button until the user icon in the upper left corner of the LCD screen flashes.
2. Press the «SET» button again to toggle between users.
3. Press the «ON/OFF» button to make your selection.



Using an A/C Power Adapter

It is possible to operate Automatic Blood Pressure Monitor model M-200A with an AC/DC adaptor.

1. Push the plug into the socket at the bottom part of the device. No power is taken from the batteries while the AC/DC adaptor is connected to the device.




2. Plug the AC adaptor into a 220/110 V power socket. The device is ready for measurement.
3. Test that power is available by pressing the ON/OFF button.

NOTE:

- Please use the AC adaptor of Trademark **Dr. Frei®**. Any other adaptor being used, the service center is not considered responsible for the warranty servicing/repair of the monitor.
- No power is taken from the batteries while the AC/DC adaptor is connected to the device.
- Please consult service center if you have questions relating to the AC/DC adaptor.

Cuff Connection

Insert the cuff connector into the opening provided on the side of the device as shown in the picture.

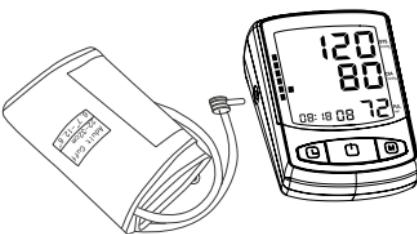


MEASUREMENT PROCEDURE

ATTENTION

- Find time to relax by sitting in a quiet atmosphere for some time before measurement.
- Efforts by the patient to support the arm can increase the blood pressure. Make sure you are in a comfortable, relaxed position and do not flex the arm during measurement.
- Always measure on the same arm (normally left).
- Remove any garment that fits closely to your upper arm. Do not roll the sleeve since it can squeeze your hand and this can lead to false results.
- Use only clinically approved original cuff.
- If you want to follow the results of your blood pressure measurements, always perform measurements at the same time of day, since blood pressure changes during the course of the day.
- Measurements should be done after a 5 minute rest to ensure accuracy.

Fitting the Cuff

1. Plug the cuff connector to the cuff socket on the device left side.
2. Stretch your left (right) arm in front of you with your palm facing up. Slide and place the cuff onto your arm to let the air tube and artery mark region toward the lower arm. Wrap and tighten the cuff above your elbow. The artery mark on the edge of the cuff should be approx. 0.8" to 1.2" (2 cm to 3 cm) above your elbow. Align the tube over the main arteries on the inside.
3. Leave a little free space between the arm and the cuff: you should be able to fit two fingers between them. Remove all clothing covering or constricting the measurement arm.
4. Press the hook material firmly against the pile material. The top and bottom edges of the cuff should be tightened evenly around your upper arm.

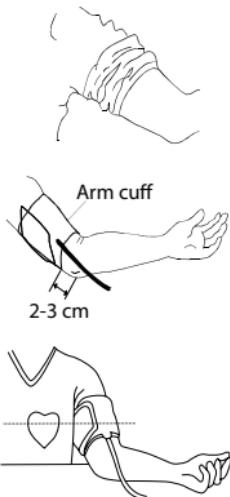


Measuring Procedure

Always apply the pressure cuff before turning on the monitor.

1. Press ON/OFF button. All icons appear two seconds on DISPLAY, then switch to measurement, and display "0" or last measurement record.



2. Pump begins to inflate the cuff. The heart symbol «♥» is shown on the display. When complete, the results will be displayed.

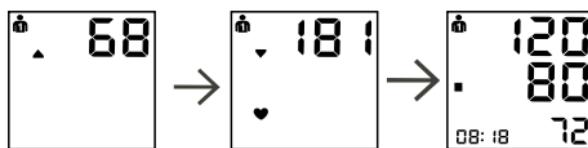



Reading Measurement Results

When the measurement has been concluded, the measured blood pressure, pulse rate and color bars classified by WHO (World Health Organization) are now displayed. The appearance of this symbol  signifies that an irregular heartbeat was detected. This indicator is only a caution.

NOTE: We recommend contacting your physician if you see this indicator frequently.

It is important that you be relaxed, remain still and do not talk during measurements.

On the graphic indicator the element showing level of arterial pressure on a scale of World Health Organization is displayed.

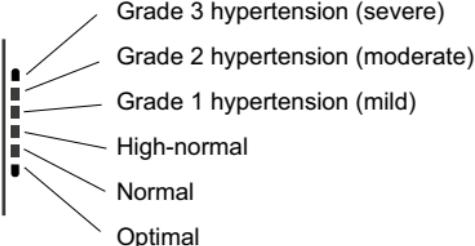

Discontinuing a Measurement

If it is necessary to interrupt a blood pressure measurement for any reason (e.g. the patient feels unwell), the ON/OFF button be pressed at any time. The device then immediately lowers the cuff pressure automatically.



MEMORY FUNCTION

At the end of a measurement, this monitor automatically stores each result with date and time. This unit stores 30 memories for each of 2 users.

Viewing the Stored Values

With the unit off, press «M» button. The display first shows **AVG**, then shows the average of the last three measurements within 10 minutes. Please note: During the last 10 minutes of the unit, if there is no memory stored, it shows

«0»; if only the last memory is stored, it shows the last memory; if there are 2 memories stored, it shows the average of the 2 memories. Besides, measurements for each user are averaged and stored separately. Be certain that you are viewing the measurements for the correct user.

Pressing the MEMORY button again displays the previous value. To view a particular stored memory, press the MEMORY button to scroll to that stored reading. If an irregular heartbeat is detected, the symbol  is displayed including the time and the result of the measurement.

Further information

Measurements should not occur soon after each other, since otherwise, the results will be falsified. Wait therefore for several minutes in a relaxed position, sitting or lying, before you repeat a measurement.

Delete Memories

Before you delete all memory readings stored in, make sure you won't need refer to them at a later date. Keeping a written record is prudent and may provide additional information for your doctor's visit.

Delete memory (all the memory will be deleted) hold «M» for 5 seconds, display «» means all the memories have been deleted.



ERROR MESSAGES/TROUBLESHOOTING

If you have trouble in using the unit please check the following points first.

ERROR DISPLAY	POSSIBLE CAUSE	HOW TO CORRECT
Nothing is displayed when you push the ON/OFF button or  battery icon flash	No battery installation	Insert batteries
	Battery worn out	Replace with new batteries
	The polarities of batteries placed wrongly	Insert battery in the correct polarities

E1: Can't normally increase pressure	Check your cuff for air leakage	Replace cuff with new one
E3: Inflate pressure too high		Remeasure or send back to dealer to recalibrate
E2 E4: Hand shaking while measurement	Hand or body shaking while measurement	Keep static position and measure again
Battery icon on	Battery low power	Replace battery and measure again
The systolic pressure value or diastolic pressure value too high	The cuff was held lower than your heart	Keep correct position and measure again
	The cuff was not attached properly	
	You moved your body or spoke during measurement	
The systolic pressure value or diastolic pressure value too low	The cuff was held higher than your heart	
	You moved your body or spoke during measurement	

ATTENTION

Should any technical malfunctions arise in the blood pressure monitor, please contact the authorized service centre of **Dr. Frei®**. **Never attempt to repair the instrument yourself!** Any unauthorized opening of the instrument invalidates all warranty claims.

NOTE: Blood pressure is subject to fluctuations even in healthy people. Please remember that comparable blood pressure measurements always require the same time and the same conditions! These are normally quiet conditions. If you follow the correct procedures described above and still get the fluctuations of blood pressure of more than 15 mmHg and/or you repeatedly hear irregular pulse tones please consult your doctor.

CARE AND MAINTENANCE

<p>Do not expose the device to either extreme temperatures, humidity, dust or direct sunlight.</p>	
<p>Handle the cuff carefully and avoid all types of stress through twisting or buckling in order not to damage the sensitive air-tight bubble.</p>	
<p>Clean the device with a soft, dry cloth. Do not use gas, thinners or similar solvents. Spots on the cuff can be removed carefully with a damp cloth and soapsuds. Do not submerge the cuff in water!</p>	
<p>Handle the tube carefully. Keep the hose away from sharp edges.</p>	
<p>Do not drop the monitor or treat it roughly in any way.</p>	
<p>Never open the monitor! Otherwise the manufacturer's calibration will be spoiled.</p>	

NOTE: According to international standards, your monitor should be checked for calibration every 2 years.

SYMBOL INFORMATION

SYMBOL	REFERENT
	Consult instructions for use
	Manufacturer
	Serial number
	Caution, consult accompanying documents
	Dispose of in accordance with the requirements of your country
	Type BF equipment
	Class II
	CE mark

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Measuring Method	Oscillometric
Indication	Digital LCD display
Measuring Range:	Pressure: (30~280) mmHg Pulse: (40~199) Beat/min
Accuracy:	Static pressure: ± 3 mmHg Pulse: $\pm 5\%$

Memory:	2 x 30 Memories
Power supply:	4x1.5 V Batteries (LR6 or AA)
Operating condition:	+5°C~+40°C, 15% RH~93% RH Atmospheric pressure: 70 kPa~106 kPa
Storage condition:	-20°C~+55°C, 0% RH~93% RH Atmospheric pressure: 50 kPa~106 kPa
Dimensions:	Approx: 90 (W) X 135 (H) X 62 (D) mm
Weight:	Approx: 380 g, excluding batteries
Classification	Type BF
Cuff size	22-42 cm
AC Adapter	Input: 100-240 V, ~50/60 HZ, 0.2 A Output: 6 V --- 500 mA

* The specifications and the outer design are subject to change for improvement reasons without previous notice.

WARRANTY

Your Automatic Blood Pressure Monitor Model M-200A is warranted for 5 years from date of purchase. Warranty for the cuff is 1 year from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by improper handling, accidents, not following the operating instructions or self-maintained alterations made to the device.

The warranty is only valid upon presentation of the warranty card which was correctly filled in and sealed.

УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ТМ DR. FREI®

Благодарим Вас за выбор автоматического измерителя артериального давления ТМ Dr. Frei® модели М-200А. Мы уверены, что, по достоинству оценив качество и надежность этого прибора, Вы станете постоянным пользователем продукции Швейцарской торговой марки Dr. Frei®. Перед тем как начать пользоваться данным прибором, внимательно прочитайте инструкцию. В ней Вы найдете всю информацию, необходимую Вам для правильного проведения измерения артериального давления и пульса.

По всем вопросам, относительно данного продукта, пожалуйста, обращайтесь к официальному представителю или в сервисный центр ТМ Dr. Frei® в Вашей стране.

ВНИМАНИЕ

Данный измеритель артериального давления предназначен для осуществления самостоятельного контроля артериального давления, а не для самодиагностики гипертонии/гипотонии. Ни в коем случае не ставьте диагноз самостоятельно на основе результатов, полученных с помощью измерителя артериального давления. В случаях отклонения артериального давления от нормы не занимайтесь самолечением, не изменяйте самостоятельно прописанные методы лечения, не проконсультировавшись предварительно с врачом.



Класс защиты BF.



Перед использованием прибора внимательно прочтите данную инструкцию.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ	
ОБ АРТЕРИАЛЬНОМ ДАВЛЕНИИ	22
Что такое артериальное давление.....	22
Нормы артериального давления	23
ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ	
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ МОДЕЛЬ М-200А.....	24
Индикатор уровня артериального давления	24
Технология выявления нарушений частоты	
сердечных сокращений (ИНВ).....	25
ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ	25
Важная информация	25
Комплектация.....	26
Внешний вид и описание прибора	26
Установка батареек	27
Установка времени/даты	27
Выбор пользователя.....	28
Подключение сетевого адаптера.....	28
Подключение манжеты.....	29
ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ	29
Наложение манжеты	30
Процесс измерения	30
Чтение результатов измерения	31
Прерывание измерения	31
ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ».....	32
Просмотр сохраненных величин	32
Удаление всех значений.....	32
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	33
ХРАНЕНИЕ И УХОД.....	34
ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ.....	35
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	36
ГАРАНТИЯ	37


ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ОБ АРТЕРИАЛЬНОМ ДАВЛЕНИИ

Что такое артериальное давление

Артериальное давление - это давление крови на стенки артерий. Артериальное давление (АД) необходимо для обеспечения постоянной циркуляции крови в организме. Благодаря ему клетки организма получают кислород, который обеспечивает их нормальное функционирование. «Насосом», выталкивающим кровь в сосуды, выступает сердце. Каждый удар сердца обеспечивает определенный уровень АД. Различают 2 вида АД: систолическое (верхнее) давление, которое соответствует сокращению сердца, при котором происходит выталкивание крови в артерии; и диастолическое (нижнее) давление, которое соответствует давлению крови между двумя сокращениями сердца.



Суточный ритм артериального давления человека

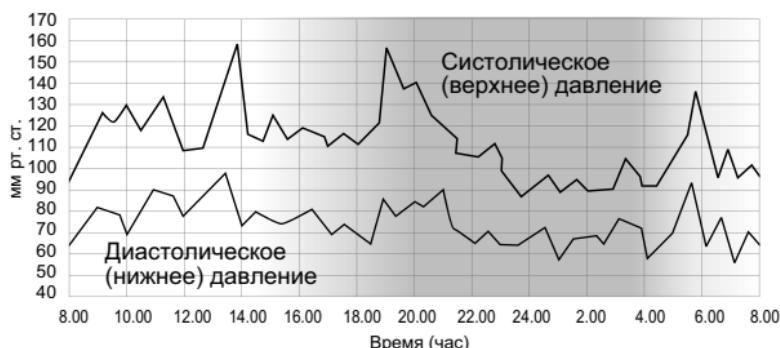

Повышение артериального давления увеличивает нагрузку на сердце, влияет на кровеносные сосуды, делая их стенки толстыми и менее эластичными.

Одной из характеристик гипертонии является то, что на начальном этапе она может протекать незаметно для самого больного. Именно поэтому самоконтроль АД играет такую важную роль. С прогрессированием болезни возникают головные боли, постоянные головокружения, ухудшается зрение, функционирование жизненно важных органов - головного мозга, сердца, почек, кровеносных сосудов.

При отсутствии соответствующей терапии возможны такие последствия, как поражения почек, стенокардия, паралич, потеря речи, слабоумие, инфаркт миокарда и инсульт головного мозга.

Нормы артериального давления

Мировым стандартом в отношении норм артериального давления является Классификация* Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ):

Диапазон	Систолическое АД (мм рт. ст.)	Диастолическое АД (мм рт. ст.)
Артериальное давление слишком низкое	< 100	< 60
Оптимальное артериальное давление	100 - 119	60 - 79
Артериальное давление в норме	120 - 129	80 - 84
Артериальное давление слегка повышенено	130 - 139	85 - 89
Артериальное давление слишком высокое	140 - 159	90 - 99
Артериальное давление чрезмерно высокое	160 - 179	100 - 109
Артериальное давление угрожающее высокое	≥ 180	≥ 110

* приведена с сокращениями.

- При диагнозе ГИПЕРТОНИЯ необходимо совмещение медикаментозного лечения, назначенного врачом, и коррекции образа жизни.
- При высоком нормальном и нормальном АД рекомендуется осуществление самоконтроля с тем, чтобы вовремя принять меры по

снижению уровня АД до оптимального без применения лекарственных средств.

- В возрасте старше 50 лет высокое (больше 140 мм рт. ст.) систолическое давление играет более важную роль, чем диастолическое давление.
- Даже при нормальном АД, риск развития гипертонии увеличивается с возрастом.

ВНИМАНИЕ

Если измеренные в состоянии покоя показатели АД не являются необычными, однако в состоянии физического или душевного утомления Вы наблюдаете чрезмерно повышенные результаты, то это может указывать на наличие так называемой лабильной (т. е. неустойчивой) гипертонии. Если у Вас имеются подозрения на это явление, рекомендуем обратиться к врачу.

Если при правильном измерении артериального давления диастолическое артериальное давление составляет более 120 мм рт. ст., необходимо незамедлительно вызвать врача.

ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, МОДЕЛЬ М-200А

Индикатор уровня артериального давления

Индикатор уровня давления расположен вдоль левого края дисплея. Классификация соответствует 6-ти диапазонам, описанным в таблице раздела «Нормы артериального давления».

После измерения АД пунктир в левой части дисплея вы светится на против той зоны, которой соответствует полученное значение АД: зеленая зона - оптимальное давление, желтая - повышенное, оранжевая - слишком высокое, красная - угрожающее высокое.

Данная функция позволит Вам самостоятельно сориентироваться в полученных результатах АД.

Технология выявления нарушений частоты сердечных сокращений (ИНВ)

Данная технология позволяет определить нерегулярное биение сердца. Если на дисплее прибора появляется символ технологии ИНВ , это означает, что во время измерения артериального давления прибор выявил какие-то нарушения частоты сердечных сокращений. Возможно, что в каком-то конкретном случае такой результат обусловлен изменением Вашего обычного артериального давления; просто повторите измерение еще раз. В большинстве случаев, поводов для беспокойства нет. Тем не менее, если символ  появляется постоянно (например, несколько раз в неделю при ежедневных измерениях), мы рекомендуем Вам сообщить об этом врачу. Пожалуйста, покажите своему врачу данное пояснение:

Информация для медиков относительно технологии выявления нарушений частоты сердечных сокращений (ИНВ)

Данный прибор представляет собой осциллометрический измеритель артериального давления с функцией анализа частоты пульса одновременно с проведением измерения. По окончании измерения на дисплее прибора появляется символ технологии ИНВ , если во время измерения артериального давления прибор выявил какие-то нарушения частоты пульса. Если символ  появляется достаточно часто (например, несколько раз в неделю при ежедневных измерениях), мы рекомендуем пройти медицинское обследование. Этот прибор ни в коем случае не заменяет кардиологического обследования, тем не менее, он позволяет выявлять нарушения частоты сердечных сокращений на ранней стадии.

ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

Важная информация

1. Используйте прибор ТОЛЬКО по назначению, как описано в этой инструкции.
2. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ аксессуары, не указанные изготовителем.
3. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор, если он работает неисправно, либо поврежден.
4. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор в местах, где присутствуют распыленные аэрозоли, и в местах, где происходит подача кислорода.

5. Ни в коем случае НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор для новорожденных или маленьких детей.
6. Этот прибор НЕ ЯВЛЯЕТСЯ средством лечения каких-либо симптомов или заболеваний. Результаты измерений служат только для информации. Обратитесь к врачу за консультацией.
7. НЕЛЬЗЯ хранить прибор и гибкий шнур на горячих поверхностях.
8. НЕ ОДЕВАЙТЕ манжету на другие участки тела, кроме плеча.
9. ВАЖНО правильно использовать и периодически проводить проверку прибора для продления его срока службы. Если Вы не уверены в точности показаний прибора, обратитесь в сервисный центр в Вашей стране.
10. Данный прибор предназначен для использования лицами старше 18 лет.
11. Не используйте прибор для постановки диагноза гипертонии и для измерения артериального давления у новорожденных, маленьких детей или лиц, не давших на это свое согласие.
12. Результаты измерений, полученные при использовании данного прибора, должен оценить ТОЛЬКО врач, если Вам поставлен диагноз аритмии или нерегулярного сердцебиения, предсердной или желудочковой экстрасистолии, мерцательной аритмии.

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ ПРИБОРА

Комплектация

В комплект входит автоматический измеритель артериального давления модели М-200А, манжета размера 22 - 42 см, 4 батарейки АА, инструкция пользователя, сетевой адаптер, гарантийный талон, упаковка.

Внешний вид и описание прибора

На рисунке представлен автоматический измеритель артериального давления модели М-200А.



Аксессуары:



Инструкция



Манжета




Адаптер

* Используйте только адаптер торговой марки Dr. Frei. во избежание каких-либо неполадок.

Установка батареек

- Снимите крышку отсека батареек, как показано на рисунке.
- Вставьте батарейки, соблюдая полярность.
- Закройте защитную крышку. Используйте только щелочные батарейки типа LR6, AA.



ВНИМАНИЕ


- Если на дисплее появляется предупреждающий символ , это значит, что батарейки практически разряжены. После появления предупреждающего символа , прибор не будет работать до тех пор, пока батарейки не будут заменены.
- Если прибор не используется в течение длительного времени, рекомендуется извлечь из него батарейки.
- Рекомендуется использовать батарейки типа AA (1,5 В). Не рекомендуется использовать заряжаемые аккумуляторы 1,2 В.
- Для проверки всех элементов дисплея удерживайте нажатой кнопку включения/выключения (ON/OFF). При нормальном функционировании прибора символы всех элементов загорятся.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для экономии батареек прибор выключается автоматически после 1 минуты бездействия или нажатием на кнопку Вкл./Выкл.


Установка времени/даты

Благодаря функции прибора «Время/дата», при каждом измерении давления можно сохранять в памяти результат измерения вместе с точным временем его проведения.

- Нажмите кнопку «», чтобы включить прибор.
- Нажмите и удерживайте кнопку «» пока на экране не начнет мигать «Год».



3. Затем, нажимая кнопку «M», выберите необходимое значение.
Подтвердите свой выбор нажатием кнопки «».
4. Точно так же, введите значения месяца, дня, часа, минут.

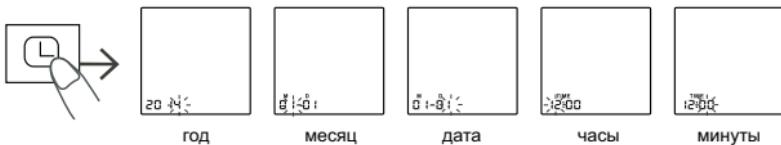

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если Вам необходимо изменить дату и время, нажмите и удерживайте нажатой в течение 3 секунд кнопку Время/Дата до тех пор, пока цифры года не начнут мигать. Затем можно вводить новые данные, следуя инструкции выше.
- При каждом нажатии на кнопки Память и Время/Дата происходит одна операция (например, переключение на следующий режим установки или изменение значения на +1)
- При удерживании кнопки можно ускорить переход в требуемый режим или поиск нужного числа.

Выбор пользователя

Данный измеритель артериального давления сохраняет в памяти 30 результатов измерений для каждого из двух пользователей. Перед началом измерения убедитесь, что Вы переключили прибор на нужного пользователя.

1. Когда прибор выключен, нажмите кнопку «SET», в левом верхнем углу экрана появится символ пользователя .
2. Нажмите еще раз кнопку «SET», чтобы переключить пользователя.
3. Нажмите кнопку Вкл./Выкл., чтобы подтвердить выбор пользователя .

Подключение сетевого адаптера

В конструкции автоматического измерителя артериального давления модели М-200А предусмотрена возможность подключения сетевого адаптера.

1. Подключите штекер адаптера к гнезду, расположенному в нижней

части прибора. При этом питание прибора от батареек автоматически отключается.

2. Подключите адаптер к источнику питания 220/110 В. Прибор готов к работе.
3. Проверьте включение прибора нажатием на кнопку Вкл./Выкл.




ПРИМЕЧАНИЕ:

- Используйте только фирменный адаптер, идущий в комплекте с тонометром. При использовании любого другого адаптера сервисный центр снимает с себя обязательства по гарантийному обслуживанию прибора.
- Батарейки не расходуются, когда адаптер переменного тока подключен к прибору.
- Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр, если у Вас имеются вопросы относительно работы устройства от переменного тока.

Подключение манжеты

Подключите соединитель манжеты к разъему, расположенному на левой панели прибора, как показано на рисунке.

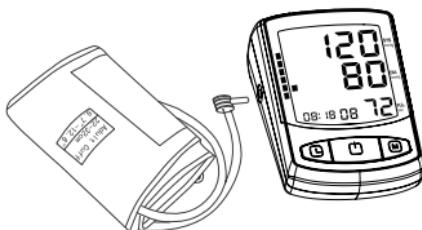

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

ВНИМАНИЕ

- Перед измерением желательно некоторое время посидеть в спокойном, расслабленном состоянии.
- Каждое напряжение пациента, например, упор на руку, может повысить артериальное давление. Уделите внимание тому, чтобы тело было приятно расслаблено, и не напрягайте во время измерения руку, на которой Вы проводите измерение.
- Измеряйте давление всегда на одной и той же руке (обычно левой).
- Освободите левую руку от одежды. Не закатывайте рукав, т.к. он сдавит Вашу руку и это приведет к неточности при измерении.

- Используйте только клинически апробированную оригинальную манжету!
- Если Вы хотите вести учет своего артериального давления, старайтесь проводить измерения в одно и то же время, поскольку артериальное давление меняется в зависимости от времени суток.
- Для того чтобы измерения происходили корректно, повторное измерение следует выполнять лишь после 5-минутного перерыва.

Наложение манжеты

1. Подсоедините манжету к прибору, вставив соединитель манжеты в гнездо для манжеты слева на приборе.
2. Расправьте и расположите левую (правую) руку перед собой ладонью вверх. Закрепите манжету на руке выше локтя. Метка артерии на краю манжеты должна быть расположена на 2 - 3 см выше локтевого сгиба, воздушная трубка - с внутренней стороны руки.
3. Между манжетой и рукой должно оставаться небольшое пространство так, чтобы можно было просунуть два пальца. Снимите одежду, покрывающую или сжимающую руку, на которой выполняется измерение.
4. Закрепите манжету на липучку плотно. Убедитесь, что верхний и нижний край манжеты расположены ровно.




Процесс измерения

Всегда включайте прибор только после того, как надета манжета.

1. Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.». Все символы в течение 2-х секунд будут отображаться на экране, потом включится режим измерения, на экране появится «0» или результат последнего измерения.



2. Манжета автоматически накачается. Индикатор «♥» будет мигать на экране. После измерения на экране отобразится результат измерения.

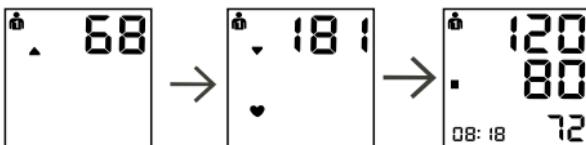

Чтение результатов измерения

После окончания измерения на дисплее высвечиваются значения артериального давления, пульса, и индикатор уровня артериального давления, соответствующий классификации Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). Появление символа означает, что прибор распознал нарушение ритмичности сердцебиения. Этот индикатор служит предупреждением.

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы рекомендуем Вам обратиться к врачу, если такой символ появляется часто (3 - 5 раз в неделю при ежедневных измерениях).

Не забывайте, что во время измерения важно сидеть расслабившись, спокойно и не разговаривая.

На графическом индикаторе отображается элемент, показывающий уровень артериального давления по шкале Всемирной организации здравоохранения.



- Артериальное давление угрожающе высокое
- Артериальное давление чрезмерно высокое
- Артериальное давление слишком высокое
- Артериальное давление слегка повышенено
- Артериальное давление в норме

Прерывание измерения

Если по какой-либо причине необходимо прервать измерение (например, из-за плохого самочувствия), нажмите кнопку Вкл./Выкл. Прибор выключится и выпустит воздух из манжеты.



ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»

После завершения измерения данный прибор автоматически сохраняет результат с датой и временем. Память прибора рассчитана на 30 измерений для каждого из двух пользователей.

Просмотр сохранных величин

Когда прибор выключен, нажмите кнопку Память. На дисплее отобразится **Avg**, затем - среднее значение трех последних измерений в течение 10 минут. Обратите внимание: если в памяти нет сохранных значений в течение 10 минут, на дисплее отобразится «0»; если в памяти сохранено только последнее значение, на дисплее отобразиться это последнее значение; если в памяти сохранено два измерения, на дисплее отобразится среднее значение этих двух измерений. При этом результаты измерений и среднее значение сохраняются в памяти отдельно для каждого пользователя. Просматривая сохранные величины, убедитесь, что Вы переключили прибор на нужного пользователя.


Нажмите на кнопку Память снова, на дисплее отобразится предыдущий результат. Для просмотра определенного результата нажмайте кнопку Память для перехода к необходимому результату. Если прибор определил аритмию, на дисплее отобразится символ , помимо результата измерения, даты и времени.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не рекомендуется выполнять измерения сразу одно за другим, так как это приводит к получению неверного результата. Отдохните несколько минут, сидя или лежа, перед следующим измерением.

Удаление всех значений

Перед тем как удалить все сохраненные значения из памяти прибора, убедитесь, что они не понадобятся Вам в будущем. При необходимости записывайте результаты измерений, на случай предоставления их врачу.

Для удаления всех сохранных значений, нажмите и удерживайте кнопку Память, пока на дисплее не отобразится мигающий символ «». Отпустите кнопку. Затем нажмите кнопку Память еще раз, пока мигает символ «» для завершения операции. Удаление отдельных измерений невозможно.

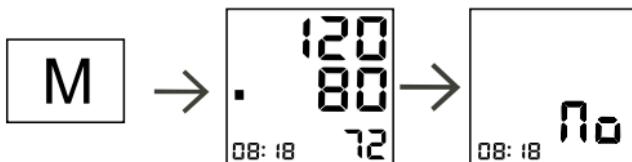

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если Вы выполняете указанные действия, но ошибка появляется снова либо появляется ошибка, которая не указана в нижеследующей таблице, обратитесь в сервисный центр. Ни в коем случае не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.

Сообщение на экране	Возможная причина	Устранение
Когда Вы нажимаете на кнопку ON/OFF на экране ничего не появляется или появляется мигающий символ разряженных батареек  .	Батарейки не вставлены	Вставьте батарейки
	Батарейки истощились	Замените батарейки на новые
	Нарушена полярность батареек	Вставьте батарейки, соблюдая полярность
E1 Не происходит нормальное накачивание манжеты	Проверьте манжету на герметичность	Замените манжету на новую
E3 Прибор накачивает слишком высокое давление в манжете		Проведите повторное измерение или отправьте прибор в сервисный центр для проверки
E2 E4 Произошли движения руки во время измерения	Рука или тело двигались во время измерения	Не двигайтесь во время измерения и произведите повторное измерение
 Символ батареек	Низкий заряд батареек	Замените батарейки и повторите измерение

Показатель систолического или диастолического давления слишком высокий	Манжета располагается ниже уровня сердца	Соблюдайте правильное положение и повторите измерение
	Манжета одета неправильно	
Показатель систолического или диастолического давления слишком низкий	Вы двигались или разговаривали во время измерения	
	Манжета располагается выше уровня сердца	
	Вы двигались или разговаривали во время измерения	

ВНИМАНИЕ

Если в измерителе артериального давления возникли неполадки технического характера, обратитесь в сервисный центр официального представителя TM Dr. Frei® в Вашей стране. **Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор!** В случае самостоятельного вскрытия прибора гарантия утрачивает силу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Уровень артериального давления имеет свойство колебаться в течение дня и у здоровых людей. Обращайте внимание на то, что, для того, чтобы иметь возможность сравнивать результаты измерений, эти измерения должны производиться приблизительно в одно и то же время и в одинаковых условиях (в состоянии покоя)! Если, несмотря на соблюдение Вами всех вышеуказанных требований, колебания давления составляют более 15 мм рт.ст. и/или Вы неоднократно слышите нерегулярные удары пульса, обратитесь к врачу.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

Храните измеритель артериального давления в сухом месте, защищенном от воздействия слишком высоких/низких температур, пыли и прямых солнечных лучей.



<p>Не перекручивайте и не заламывайте манжету, чтобы не повредить находящийся в ней чувствительный вкладыш.</p>	
<p>Для чистки измерителя используйте чистую мягкую тканевую салфетку. Не используйте бензин, растворитель и прочие подобные средства. Пятна на манжете осторожно удаляйте с помощью ткани, увлажненной мыльным раствором. Не стирайте манжету!</p>	
<p>Осторожно обращайтесь с соединительным воздушным шлангом. Оберегайте манжету и резиновые трубы от острых предметов.</p>	
<p>Не роняйте измеритель и не применяйте силу при его использовании.</p>	
<p>Никогда не вскрывайте прибор! В противном случае нарушится заводская калибровка прибора.</p>	

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

СИМВОЛ	ОПИСАНИЕ
	Смотрите инструкцию пользователя
	Производитель

SN	Серийный номер
	Внимание, см. сопроводительные документы
	Утилизируйте в соответствии с требованиями в Вашей стране
	Оборудование типа BF
	Класс защиты II
	Маркировка CE

Периодическая калибровка прибора

Точность измерительных приборов должна время от времени проверяться. По этой причине рекомендуется периодически, раз в два года, проверять индикацию статистического давления. Более подробную информацию Вы можете получить в сервисном центре.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод измерения	Осциллометрический
Индикация	Цифровой ЖК-дисплей
Диапазон измерений:	Давление: 30 - 280 мм рт.ст. Пульс: 40 - 199 уд/мин.
Точность измерения:	Давление: ± 3 мм рт.ст. Пульс: $\pm 5\%$
Память:	30 измерений для каждого из 2 пользователей
Источник питания:	Батарейки 4x1,5В (LR6 или AA)
Диапазон рабочих температур:	+5 - +40 °C, относительная влажность: 15% - 93%, атмосферное давление: 70 кПа ~ 106 кПа

Условия хранения:	-20 - +55 °C, относительная влажность: 0% - 93%, атмосферное давление: 50 кПа ~ 106 кПа
Размеры прибора:	135 (длина) x 90 (ширина) x 62 (высота) мм
Вес:	380 г без батареек
Размер манжеты	22 - 42 см
Классификация	Тип ВF
Сетевой адаптер	Вход: 100 - 240 В, ~50/60 Гц, 0.2 А Выход: 6 В = 500 мА

* Возможны технические изменения и изменения дизайна без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЯ

На автоматический измеритель артериального давления модели М-200А распространяется гарантия сроком 5 лет со дня приобретения. Гарантия на манжету - 1 год со дня приобретения. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного обращения, несчастных случаев, несоблюдения инструкции по эксплуатации или самостоятельных попыток вскрыть и/или отремонтировать прибор.

Гарантия действует только в случае предъявления в сервисный центр правильно заполненного гарантийного талона с печатью торговой организации.

GERBIAMAS DR. FREI AUTOMATINIO ARTERINIO KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIO VARTOTOJAU

Gerbiamas Dr. Frei® automatinio arterinio kraujospūdžio matuoklio vartotojau Dėkojame, kad pasirinkote mūsų automatinį arterinio kraujospūdžio matuoklį Dr. Frei® (modelis M-200A). Esame įsitikinę, kad, įvertinę aukštą kokybę ir patikimumą šio produkto, jūs tapsite vartotoju daugelio produktų šveicariško prekės ženkle Dr. Frei®.

Prieš pradėdami naudotis šiuo prietaisu, atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Čia rasite visą informaciją, reikalingą tinkamiams arterinio kraujospūdžio ir pulso dažnumo matavimams atliliki. Dėl visų klausimų, susijusių su šiuo gaminiu, kreipkitės į oficialų atstovą ar paslaugų centro TM Dr. Frei® jūsų salyje.

DĖMESIO!

Šis kraujospūdžio matuoklis skirtas savarankiškai arterinio kraujospūdžio kontrolei, o ne savarankiškai hipertonijos/hipotonijos diagnostikai. Jokiu būdu nebandykite patys nustatyti diagnozę, remdamiesi tik arterinio kraujospūdžio matuoklio pagalba gautais rezultatais. Neleidžiama savarankiškai gydyti su arteriniu kraujospūdžiu susijusias problemas arba keisti gydytojo paskirtus gydymo metodus, nepasitarus su gydytoju.



Apsaugos klasė BF.



Prieš prietaiso naudojimą atidžiai susipažinkite su šia instrukcija.

KĄ REIKIA ŽINOTI APIE ARTERINĮ KRAUJOSPŪDĮ?	40
Kas yra arterinis kraujospūdis?	40
Arterinio kraujospūdžio normos	41
PRIVALUMAI AUTOMATINIO	
KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIO M-200A	42
Arterinio kraujospūdžio indikatorius	42
Širdies aritmijos (IHB) indikatorius	42
PASIRUOŠIMAS MATAVIMUI	42
Svarbi informacija	43
Komplektacija	43
Prietaiso išorinis vaizdas ir aprašymas	43
Elementų įdėjimas	44
Laiko/datos nustatymas	45
Vartotojo pasirinkimas	45
Tinklo adapterio pajungimas	46
Rankovės prijungimas	46
MATAVIMO PROCEDŪRA	46
Manžetės uždėjimas	47
Matavimo procesas	47
Matavimo rezultatų skaitymas	48
Matavimo nutraukimas	48
FUNKCIJA «ATMINTIS»	49
Irašytų duomenų peržiūra	49
Visų matavimų duomenų valymas	49
GEDIMŲ PAŠALINIMAS	50
SAUGOJIMAS IR PRIEŽIŪRA	51
APRAŠYMAS SIMBOLIŲ	52
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS	53
GARANTIJA	54

KĄ REIKIA ŽINOTI APIE ARTERINĮ KRAUJOSPŪDĮ?


Kas yra arterinis kraujospūdis?

Arterinis kraujospūdis - tai krauso slėgis į arterijų sieneles. Arterinis kraujospūdis (AKS) užtikrina krauso nuolatinę cirkulaciją organizme. Jo dėka organizmo ląstelės gauna deguojį, užtikrinantį jų normalų funkcionavimą. Širdis veikia kaip siurblys - su kiekvienu jos raumens susitraukimu arterijoje padidėja slėgis. Kiekvienas širdies dūžis užtikrina tam tikrą AKS lygi.

Yra 2 AKS rūšys: sistolinis (maksimalus) kraujospūdis - tai kraujospūdis, kuris būna didžiausias skilvelių sistolės metu, kai kraujas stumte išstumiamas į aortą; ir diastolinis (minimalus) kraujospūdis, kuris širdies diastolės metu sumažėja.



Žmogaus arterinio kraujospūdžio paros ritmas

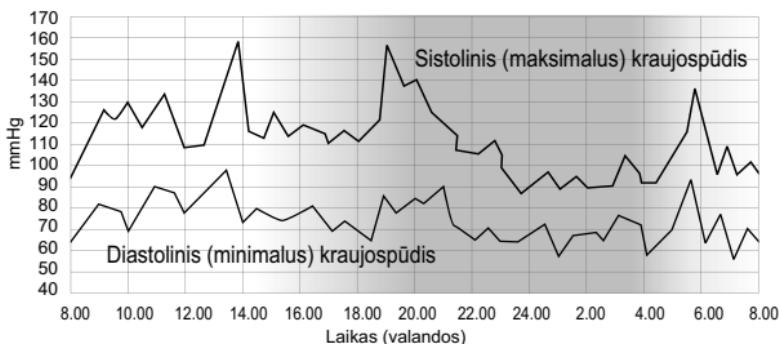

Arterinio kraujospūdžio padidėjimas padidina širdies krūvį, paveikia kraujagysles, padarydamas jų sieneles storomis ir mažiau elastingomis. Viena hipertonijos charakteristika yra tai, kad pradiniame etape jis eina nepastebimai. Būtent todėl AKS savikontrolė vaidina tokį svarbų vaidmenį. Ligai progresuojant, pasireiškia galvos skausmas, nuolatinis galvos svaigimas, blogėja regėjimas ir gyvybiškai svarbių organų - smegenų, širdies, inkstų bei kraujagyslių - funkcionavimas.

Jei nėra taikomos atitinkamas gydymas, tai galimos tokios padidėjusio arterinio kraujospūdžio pasekmės, kaip inkstų pažeidimas, krūtinės angina, smegenų insultas, kalbos praradimas, demencija, miokardo infarktas ir smegenų insultas.

Arterinio kraujospūdžio normos

Pasaulyje standartas kraujospūdžio standartų klasifikacija* Pasaulio Sveikatos Organizacija (PSO):

Kategorija	Sistolinis (mmHg)	Diastolinis (mmHg)
Arterinis krauko spaudimas yra per mažas	< 100	< 60
Optimalus	100 - 119	60 - 79
Normalus	120 - 129	80 - 84
Aukštas normalus	130 - 139	85 - 89
I Laipsnio Hipertenzija	140 - 159	90 - 99
II Laipsnio Hipertenzija	160 - 179	100 - 109
III Laipsnio Hipertenzija	≥ 180	≥ 110

- * skaitykite santrumpą.
- Turint diagnozę HIPERTONIJA, reikia sujungti gydytojo paskirtą medikamentinį gydymą su gyvenimo būdo koregavimu.
- Esant aukštam normaliam ir normaliam AKS rekomenduojama atliki savikontrolę, siekiant laiku imtis tam tikrų priemonių, skirtų sumažinti AKS iki optimalaus be vaistų naudojimo.
- Amžiuje virš 50 metų aukštas (didesnis nei 140 mmHg), sistolinis kraujospūdis vaidina svarbesnį vaidmenį, negu diastolinis kraujospūdis.
- Net esant normaliam AKS, hipertonijos tolesnės eigos rizika didėja su amžiumi.

DĒMESIO!

Jei ramybės būsenoje išmatuoti AKS rezultatai nėra neįprasti, tačiau kai esate fiziškai arba psichologiškai pavargę matavimo rezultatai yra per aukšti, tai gali nurodyti į taip vadinamą labilią (t.y. nestabilią) hipertonią. Jei įtariate, jog turite tokią hipertonią, rekomenduojame kreiptis į gydytoją.

Jei teisingai matuojant kraujospūdį, diastolinis kraujospūdis yra didesnis nei 120 mmHg, reikia nedelsiant iškvesti gydytoją.

PRIVALUMAI AUTOMATINIO KRAUJOSPŪDŽIO MATUOKLIO M-200A

Arterinio kraujospūdžio indikatorius

Kraujospūdžio dydžio indikatorius kairiajame ekrano krašte. Klasifikacija atitinka diapazonams, aprašytiems «Arterinio kraujospūdžio normų» skyriaus lentelėje. Atlikus arterinio kraujospūdžio matavimą kairioje ekrano dalyje rodomas atitinkamos spalvos punktyras: žalia zona - optimalus kraujospūdis, geltona - padidėjęs, oranžinė - labai aukštas, raudona - grėsmingas. Ši funkcija Jums leis savarankiškai įvertinti arterinio kraujospūdžio matavimo rezultatus.

Širdies aritmijos (IHB) indikatorius

Ši technologija leidžia nustatyti nereguliarų širdies plakimą. Jei ekrane pasirodo technologijos IH[†] simbolis, vadinasi arterinio kraujospūdžio matavimo metu buvo nustatytas tam tikras pulso ritmo sutrikimas. Galbūt tam tikru atveju tai buvo sukelta Jūsų normalaus arterinio kraujospūdžio pokyčiais; paprastai atlikite matavimą dar kartą. Daugeliu atvejų nėra jokio pagrindo nerimauti. Tačiau šiam simbolui [†] pasirodant pastoviai (pvz. keletą kartų per savaitę, kai matuojama kas dieną), rekomenduojame apie tai informuoti gydytoją. Prašome perduoti savo gydytojui ši paaiškinimą:

Informacija gydytojui apie dažnai pasirodantį aritmijos (IHB) indikatorių

Šis prietaisas - oscilometrinis kraujospūdžio matuoklis, matavimo metu analizuojantis pulso dažnumą. Prietaisas kliniškai patikrintas. Technologijos IH[†] simbolis parodomas po to arterinio kraujospūdžio matavimo, kurio metu buvo nustatytas neritmiškas pulso dažumas. Šiam simbolui [†] pasirodant dažniau (pvz. keletą kartų per savaitę, kai matuojama kas dieną), pacientui patartina kreiptis medicininės pagalbos. Prietaisas jokiu atveju negali pakeisti išsamaus kardiologinio patikrinimo, tačiau padeda ankstyvoje fazėje pastebėti pulso dažnumo sutrikimus.

PASIRUOŠIMAS MATAVIMUI

Svarbi informacija

1. Prietaisą naudokite TIK pagal paskirtį, aprašytą šioje instrukcijoje.
2. NENAUDOKITE priedų, kurių nenurodė gamintojas.
3. NENAUDOKITE prietaiso, jeigu jis blogai veikia ar sugedo.
4. NENAUDOKITE prietaiso vietose, kur yra aerozolių lašelių, kur vyksta deguonies padavimas.
5. Kategoriškai DRAUDŽIAMA naudoti prietaisą naujagimiams ar mažamečiams vaikams.
6. Šis prietaisas NĒRA kokių nors simptomų ar ligų gydymo prietaisas. Kraujospūdžio matavimo rezultatai tik pateikia informaciją. Konsultuokitės su gydytoju.
7. DRAUDŽIAMA prietaisą ir lankstų laidą laikyti ant karštų paviršių.
8. Manžetės nedėti ant jokių kitų kūno vietų, išskyrus žastą.
9. SVARBU teisingai naudoti ir periodiškai atlikti prietaiso patikrą, siekiant prailginti jo tarnavimo laiką. Jeigu prietaiso parodymai kelia abejones, kreipkitės į vietinį serviso centrą.
10. Prietaisas skirtas naudoti vyresniems nei 18 metų amžiaus asmenims. Nenaudokite prietaiso hipertenzijos diagnozės nustatymui bei naujagimių, mažamečių vaikų bei asmenų, neišreiškusių sutikimo, arterinio kraujospūdžio matavimui.
11. Jeigu Jums diagnozuota sunki aritmija ar nereguliarus širdies plakimas, prieširdžių ar skilvelių aritmija, tai šiuo prietaisu atliktų matavimų rezultatus gali įvertinti TIK gydytojas.
12. NENAUDOKITE prietaiso arti stiprus elektromagnetinio spinduliaivimo šaltinio (pavyzdžiui, mobilusis telefonas, mikrobangų krosnelė), nes tai gali sutrukdyti tiksliam prietaiso veikimui.


ŠIAI INSTRUKCIJAI IŠSAUGOKITE VISĄ PRIETAISO EKSPLOATAVIMO LAIKĄ

Komplektacija

Komplektą sudaro automatinis arterinio kraujospūdžio M-200A modelio matuoklis, (22-42 cm) rankovė, 4-ių AA elementų komplektas, tinklo adapteris, naudojimo instrukcija, garantiniis lapas, pakuotė.

Prietaiso išorinis vaizdas ir aprašymas

Figūros rodo automatinio arterinio kraujospūdžio M-200A modelio matuoklį.

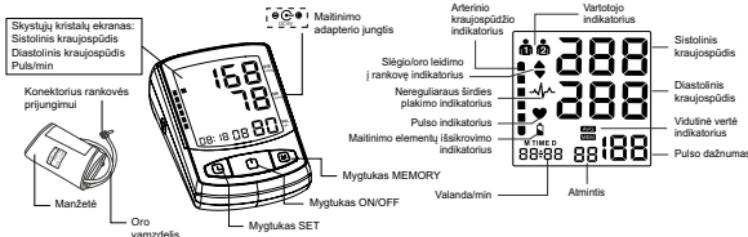

Komplekto:



Instrukcija



Manžetė




Adapteris

* Naudokite tik Dr. Frei® adapter išvengti bet kokios problemos.

Elementų įdėjimas

- Nuimkite maitinimo elementų skyrelio, esančio užpakalinėje prietaiso dalyje, dangtelį (žr.paveiksluku).
- Įdėkite elementus, laikydamiesi poliariskumo.
- Uždarykite dangtelį. Naudokite tik LR6, AA baterijas.



DĖMESIO



- Jeigu ekrane atsiranda įspėjamasis simbolis , tai reiškia, kad elementai beveik išsikrovę. Po įspėjamojo simbolio , neatsiranda, jeigu elementai visiškai išsikrovę.
- Išimkite elementus, jeigu prietaisas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Rekomenduojama naudoti AA (1,5 V) tipo elementus. Nerekomenduojama naudoti įkraunamų akumuliatorių 1,2 V.
- Kad patikrintumėte visus displejaus elementus, laikykite nuspauštą įjungimo/įjungimo mygtuką (ON/OFF). Prietaisui funkcionuojant normaliai, užsidegs visų elementų simbolai.

PASTABA: Prietaisas išsijungia automatiškai, jei esant nustatymų režimui 1 minutę neatliekami jokie veiksmai.

Laiko/datos nustatymas

Kraujospūdžio matuoklis turi datos ir laiko funkciją. Laikas ir data yra įrašomi kartu su spaudimo ir pulso rodmenimis.

- Paspauskite «», mygtuką, kad įjungtumėte monitorių.
- Paspauskite ir palaikykite «» mygtuką, kol pradės rodyti metų skaičius ir mirksėti, tada ekrane įvestas nustatymo režimas.
- Paspauskite «M», kad nustatyti metus. Patvirtinkite savo pasirinkimą paspaudami mygtuką «».
- Atlikite tuos pačius veiksmus, norėdami pasirinkti mėnesį, dieną, valandą, ir minutes.

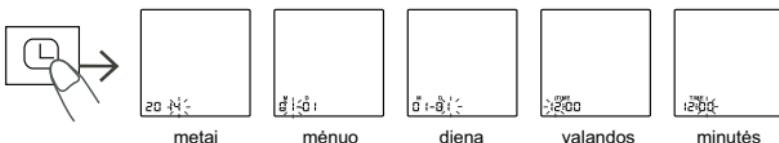

PASTABA:

- Jei reikia keisti datą ir laiką, paspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką «Laikas/data» 3 sekundes, kol pradės mirksėti metų skaičiai. Po to bus galima įvesti naujus duomenis vykdant aukščiau pateiktas instrukcijas.
- Kaskart paspaudus mygtuką «Atmintis» ir «Laikas/data», atliekama viena operacija (pvz., persijungama į kitą nustatymo režimą arba vertė pakeičiamama +1).
- Kai mygtukas laikomas nuspaustas, galima paspartinti perėjimą prie reikalingo režimo arba rasti norimą skaičių.

Vartotojo pasirinkimas

Šiame arterinio spaudimo matavimo aparate atmintyje išsaugoma 30 matavimo rezultatų kiekvienam iš dviejų nustatyti vartotojų. Prieš pradėdami matavimą patirkinkite, kad būtų įjungtas reikalingas vartotojas.

- Kai prietaisas išjungtas, nuspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką «SET», kol nepradės mirksėti vartotojo simbolis ekrano kairiajame viršutiniame kampe.
- Norédami perjungti vartotoją, nuspauskite mygtuką «SET».
- Nuspauskite mygtuką ./, patvirtindami pasirinktą vartotoją.



Tinklo adapterio pajungimas

Automatinis kraujospūdžio matuoklis M-200A gali veikti tinklo adapterio pagalba pajungus į elektros tinklą.

1. Kabelio mikro jungtį pajungti į lizdą dešinėje prietaiso pusėje.
2. Tinklo adapterį įjungti į 110 - 220 V įtampos elektros rozetę.
3. Patikrinkite prietaiso veikimas pa-spausdami įjungimo/išjungimo mygtuką.




PASTABA:

- Naudokite tik Dr. Frei® adapterį. Pasinaudojant bet kokiui kitu adapteriu, serviso centras nepriima jokių garantinių įsipareigojimų.
- Baterijos nėra sunaudojamos, kai kintamosios srovės adapteris pri-jungtas prie prietaiso.
- Kilus klausimams dėl prietaiso veikimo nuo kintamosios srovės, pra-šom kreiptis į įmonė-pardavėją ar serviso centrą.

Rankovės prijungimas

Ikiškite rankovės sujungiklį į lizdą, esantį prietaiso panelėje, kaip parodyta paveikslėlyje.

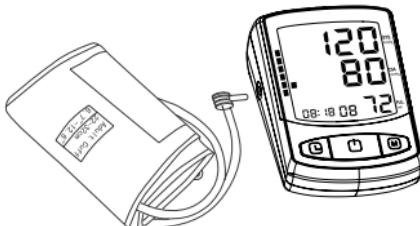

MATAVIMO PROCEDŪRA

DĖMESIO:

- Prieš matuojant kraujospūdį rekomenduojama keletą minučių raimiai, atspalaidavus pasédėti.
- Kiekvienas pacientas įsitempimas, pavyzdžiui, rankos raumens, gali pa-didinti arterinį kraujospūdį. Jūsų kūnas turi būti malonai atpalaiduotas, kraujospūdžio matavimo metu negalima įtempti jokio rankos, kurioje ma-tuojate kraujospūdį, raumens.
- Kraujospūdį matuokite vienoje ir toje pačioje rankoje (paprastai - kai-rėje).

- Ištraukite ranką iš drabužių. NEATRAITOKITE rankovės, nes ji suspaus Jūsų ranką, todėl matavimas bus netikslus.
- Naudokite tik kliniškai patvirtintą originalią manžetę!
- Norédami fiksuooti savo arterinio kraujospūdžio reikšmes, stenkitės matavimą atliki vienu ir tuo pačiu metu, nes paros eigoje arterinis kraujospūdis kinta.
- Norint teisingai atliki matavimus, pakartotinį matavimą reikia atliki tik praėjus 5 minutėms po ankstesnio matavimo.

Manžetės uždėjimas

1. Manžetę prijunkite prie prietaiso, įkišdami manžetės sujungimą į lizdą, esantį kairėje prietaiso pusėje.
2. Ištieskite ir padékite kairę (dešinę) ranką prieš save delnu aukštyn. Manžetę pritvirtinkite ant rankos aukščiau alkūnės. Ant manžetės esanti arterijos žymė turi būti 2 - 3 cm aukščiau už alkūnės sulenkimą, oro vamzdelis-iš vidinės rankos pusės.
3. Tarp manžetės ir rankos turi likti mažas tarpelis, j kurį būtų galima įkišti du pirštus. Nusirenkite rūbus, kurie dengia arba spaudžia ranką, kurioje atliekamas matavimas.
4. Manžetę užfiksukite kibia kontaktine juoste. Įsitikinkite, kad viršutinis ir apatinis manžetės kraštai eina lygiai.




Matavimo procesas

Prietaisą visada įjunkite tik po to, kai uždėta manžetė.

1. Paspauskite mygtuką ON/OFF (Įjungimas/Išjungimas). Po 2 sekundžių ekrane pasirodys visi simboliai, paskui įsijungs matavimo režimas, ekrane atsiras «0» arba paskutinio matavimo rezultatas.



2. Į rankovę automatiškai bus pumpuojamas oras. Indikatorius «♥» mirksės ekrane. Po matavimo ekrane pasirodys matavimo rezultatas.

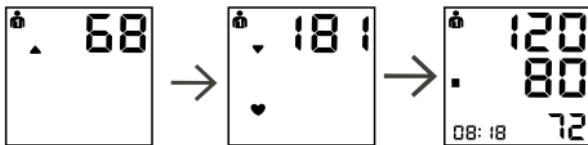


Matavimo rezultatų skaitymas

Ilgas pyptelėjimas reiškia, kad matavimo procedūra pasibaigė. Ekrane pasirodo arterinis kraujospūdis, pulso dažumas, arterinio kraujospūdžio lygi pagal Pasaulinės sveikatos organizacijos skalę.

Širdies simbolio pasirodymas reiškia, kad prietaisas atpažino širdies ritmo sutrikimus. Tai yra jspėjimas.

PASTABA: Rekomenduojame Jums kreiptis į gydytoją, jei tokis simbolis atsiranda dažnai (3 - 5 kartus į savaitę matuojant kasdien).

Nepamirškite, kad matavimo metu svarbu sédėti atsipalaidavus ir ramiai bei nekalbėti. Grafiniame indikatoriuje vaizduojamas elementas, rodantis arterinio kraujospūdžio lygi pagal Pasaulinės sveikatos organizacijos skalę.

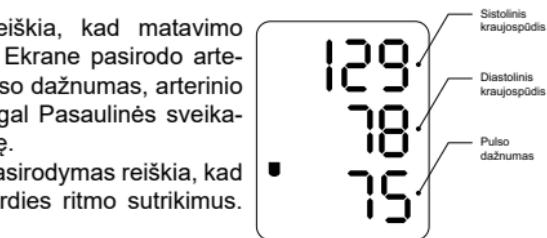

- Arterinis kraujospūdis pavojingai aukštas
- Arterinis kraujospūdis pernelyg aukštas
- Arterinis kraujospūdis per aukštas
- Arterinis kraujospūdis truputį padidėjęs
- Arterinis kraujospūdis normalus
- Optimalus arterinis kraujospūdis

Matavimo nutraukimas

Jei dėl kokios nors priežasties reikia nutraukti matavimą (pvz., dėl blogos savijautos), paspauskite mygtuką **Ijungimas/Išjungimas**. Prietaisas išsijungia ir išleis orą iš manžetės.



FUNKCIJA «ATMINTIS»

Baigus matavimą, prietaisas automatiškai išsaugo rezultatą su data ir laiku. Atmintyje telpa 30 matavimų kiekvienam iš dviejų vartotojų.

Irašytų duomenų peržiūra

Kai gaminys išjungtas, nuspauskite «M» mygtuką. Ekrane pirmiausia bus **AVG** parodytas paskutinių trijų matavimų per paskutines 10 minučių vidurkis. Atkreipkite dėmesį: Per paskutines 10 minučių jei nėra saugomos atminties, tai rodomas «0»; jei tik paskutinė atmintis saugoma, tai rodama paskutinio matavimo vertė; jei du matavimų parodymai saugomi, tai rodomas vidurkis dviejų paskutinių prisiminimų. Be to matavimų vidurkiai saugomi kiekvienam vartotojui atskirai. Būkite tikri, kad jūs žiūrite į matavimus, kurie yra reikiamu vartotojo. Paspaudus MEMORY (atminties) mygtuką dar kartą parodoma ankstesnė vertė. Norint peržiūrėti tam tikrą įrašą paspauskite MEMORY mygtuką ir pereikite iki norimo įrašo. Jei matavimo metu aptinkamas širdies ritmo sutrikimas, simbolis yra rodomas kartu su laiko ir kraujospūdžio matavimo rezultatu.


Tolimesnė informacija

Sekantis matavimas neturėtų būti atliekamas iškart po buvusio, nes kai tai rezultatai bus netikslūs. Todėl palaukite keletą minučių atsipalaivimo pozijoje, sédėjimo ar gulėjimo, prieš atliekant pakartotinį matavimą.

Visų matavimų duomenų valymas

Prieš ištrindami visus atminties duomenis, būkite įsitikinę, kad jums nereikės jų vėliau. Laikykite rašytinį dokumentą, tai gali būti papildoma informacija jūsų gydytojui vizito metu.

Atminties ištrynimui (visa atmintis bus ištrinta) Laikykite paspaudę «M» 5 sekundes, ekrane pasirodys «» tai reiškia, kad visi prieš tai įsiminti parodymai buvo ištinti.

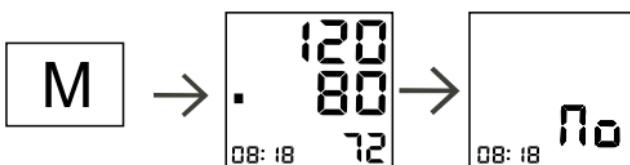

GEDIMŲ PAŠALINIMAS

Jeigu Jūs atliekate nurodytus veiksmus, tačiau pasikartoja kaida arba atsiranda kaida, kuri nenurodyta pateikiamoje lentelėje, kreipkitės į serviso centrą. Jokias būdais savarankiškai neremontuokite prietaiso.

Pranešimas ekrane	Galima priežastis	Pašalinimas
Kai paspaudžiate mygtuką ON/OFF, ekrane nieko neatsiranda arba atsiranda mirksintis išsikrovusių elementų simbolis ☐.	Elementai nejdėti Elementai išsikrovė Pažeistas elementų polišumas	Įdékite elementus Pakeiskite elementus naujais Įdékite elementus, laikantis polišumo
E1 Nevyksta normalus oro pumpavimas į rankovę	Patikrinkite rankovės sandarumą	Pakeiskite rankovę į naują
E3 Prietaisas pripumpuoja per didelį slėgi į rankovę		Atlikite pakartotinį matavimą arba nuneškite prietaisą į serviso centrą patikrinimui
E2 E4 Matavimo metu buvo pajudinta ranka	Matavimo metu buvo judinama ranka arba kūnas	Nejudékite matavimo metu ir atlikite pakartotinį matavimą
☐ Elementų simbolis	Žemas elementų įkrovimo lygis	Pakeiskite elementus ir pakartokite matavimą
Sistolinio arba diastolinio kraujospūdžio rodiklis labai aukštas	Rankovė užmauta žemiau širdies lygio Rankovė užmauta neteisingai Jūs judėjote arba kalbėjote matavimo metu	Laikykitės teisingos padėties ir pakartokite matavimą

Sistolinio arba dias-tolinio kraujospūdžio rodiklis labai žemas	Rankovė yra aukščiau širdies lygio Jūs judėjote arba kalbėjote matavimo metu	Laikykite teisingos padėties ir pakartoki-te matavimą
---	---	---

DĖMESIO!

Jei arterinio kraujospūdžio matuoklis turi techninio pobūdžio problemų, kreipkitės į Jums prietaisą pardavusią parduotuvę arba į **Dr. Frei®** serviso centrą. Jokiu atveju nebandykite patys remontuoti prietaiso! Jums savarankiškai atidarius prietaisą, garantija nebus taikoma.

PASTABA: Arterinio kraujospūdžio lygis paprastai svyruoja per dieną net sveikiems žmonėms. Atnkreipkite dėmesį į tai, kad užtikrintų korektišką matavimo rezultatų palyginimą, matavimai turi būti atliekami apytikriaus tuo pačiu laiku ir tomis pačiomis sąlygomis (ramybės būsenoje)! Jei vis tiek kraujospūdžio svyravimai sudaro daugiau nei 15 mm Hg ir/ arba Jūs ne kartą girdite nereguliarų pulso plakimą, kreipkitės į gydytoją.

SAUGOJIMAS IR PRIEŽIŪRA

Laikykite arterinio kraujospūdžio matuoklį sausoje vietoje, apsaugotoje nuo per aukštostos/žemos temperatūros, dulkių ir tiesioginių saulės spindulių.	
Manžetės viduje esantį jautrų idéklą lengva pažeisti, todėl nesukite ir nelenkite jos.	

<p>Matuoklį valykite švaria minkšta servetėle. Nenaudokite valymui benzino, skiediklių bei kitų panašių priemonių. Dėmes ant manžetės atsargiai nuvalykite muiluotu vandeniu sudrėkintu skudurėliu. Neplaukite manžetės!</p>	
<p>Atsargiai elkitės su jungiamuoju oro laidu. Saugokite manžetę ir guminis vamzdelius nuo aštrių daiktų.</p>	
<p>Nemeskite matuoklio ir nenaudokite jėgos matuodami kraujospūdį.</p>	
<p>Niekuomet neatidarykite prietaiso! Priešingu atveju bus pažeistas prietaiso gamyklinis kalibravimas.</p>	

APRAŠYMAS SIMBOLIAI

SIMPOLIAI	PAAIŠKINIMAS
	Skaitykite vartotojo instrukciją
	Gamintojas
	Serijinis numeris
	Dėmesio, skaitykite lydinčius dokumentus

	Utilizaciją atlikite pagal Jūsų šalyje galiojančius reikalavimus
	BF tipo įrenginys
	II apsaugos klasė
	CE žymėjimas

Reguliarus tikslumo patikrinimas

Būtina kartkarčiais tikrinti matavimo prietaisų tikslumą. Todėl rekomenduojama reguliarai (kas 2 metus) tikrinti statinio slėgio duomenis. Smulkesnę informaciją galima gauti **Dr. Frei®** serviso centre.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Matavimo metodas	Oscilometrinis
Indikacija	Skystujų kristalų ekranas
Matavimo diapazonas:	Slėgis: 30 - 280 mmHg. Pulsas: 40 - 199 dūžiai per minutę.
Matavimo tikslumas:	Slėgis: ± 3 mmHg; Pulsas: $\pm 5\%$
Atmintis:	30 matavimų rezultatų kiekvienam vartotojui
Maitinimo šaltinis:	4 AA ir LR6 elementai (1,5 V)
Darbinės temperatūros diapazonas:	Nuo + 5 °C iki + 40 °C, esant 15% - 93% santykinei oro drégmei, atmosferos slėgis: 70 kPa - 106 kPa
Laikymo temperatūra:	Nuo - 20 °C iki + 55 °C, esant 0 - 93% santykinei oro drégmei, atmosferos slėgis: 50 kPa - 106 kPa
Prietaiso dydis:	135 (ilgis) x 90 (plotis) x 62 (aukštis) mm
Svoris:	380 g su maitinimo elementais

Klasifikacija	BF tipo
Manžetės ilgis	22 - 42 cm
Tinklo adapteris	Jėjimas: 100-240 V, ~50/60 Hz, 0.2 A Išėjimas: 6 V === 500 mA

* Galimi techniniai bei dizaino pakeitimai be iš ankstinio įspėjimo.

GARANTIJA

Automatiniam arterinio kraujospūdžio matuokliui (modelis M-200A) su-teikiama 5 penkerių garantija nuo pardavimo datos. Manžetės garantijos laikotarpis - vieneri metai nuo įsigijimo datos. Garantija negalioja paželdimams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo, nelaimingų atsitikimų, naudojimosi instrukcijos nuostatų nesilaikymo arba savarankiškų bandymų atidaryti ir/arba suremontuoti prietaisą. Garantija galioja tik pateikus serviso centriui teisingai užpildytą garantinių talonų su pardavusios įmonės antspaudu.

DĀRGAIS DR. FREI® AUTOMĀTISKĀ ARTERIĀLĀ SPIEDIENA MĒRĪTĀJA LIETOTĀJ!

Mēs Jums pateicamies par TM **Dr. Frei®** automātiskā arteriālā spiediena mērītāja modeļa M-200A iegādi. Mēs esam pārliecināti, ka Jūs pilnībā novērtēsiet šīs ierīces kvalitāti un uzticamību un ka Jūs kļūsiet par tirdzniecības markas **Dr. Frei®** pastāvīgu lietotāju.

Pirms uzsākt ierīces lietošanu, lūdzu uzmanīgi izlasiet instrukciju. Instrukcijā Jūs atradīsiet visu informāciju, kura Jums būs nepieciešama arteriālā spiediena un pulsa mērījumu veikšanai. Par visiem jautājumiem par šo produktu, lūdzu, sazinieties ar oficiālo pārstāvi vai klientu apkalpošanas centru TM **Dr. Frei®** jūsu valstī.

UZMANĪBU

Šīs arteriālā spiediena mērītājs ir paredzēts arteriālā spiediena paškontroles veikšanai, nevis hipertonijas/hipotonijas pašdiagnostikai. Nekādā gadījumā patstāvīgi neuzstādīt diagnozi, kura balstīta uz ar arteriālā spiediena mērītāja palīdzību iegūtajiem rezultātiem. Neveiciet arteriālā spiediena pašārstēšanu un bez konsultēšanās ar ārstu patstāvīgi nemainiet Jums izrakstītās ārstēšanas metodes.



Aizsardzības klase BF.



Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

SATURS

KAS IR JĀZINA PAR ARTERIĀLO SPIEDIENU	57
Kas ir arteriālais spiediens?.....	57
Arteriālā spiediena normas.....	58
MODEĻA M-200A AUTOMĀTISKĀ ARTERIĀLĀ SPIEDIENA MĒRĪTĀJA PRIEKŠROCĪBAS	59
Arteriālā spiediena līmeņa indikators.....	59
Sirds saraušanās biežuma traucējumu noteikšanas tehnoloģija (IHB).....	59
SAGATAVOŠANĀS MĒRĪJUMIEM	60
Svarīga informācija.....	60
Komplektācija	60
Ārējais izskats un iekārtas apraksts	61
Bateriju uzstādīšana	61
Laika/datuma iestatīšana.....	62
Lietotāja izvēle.....	62
Tīkla barošanas adaptera pieslēgšana.....	63
Manšetes pieslēgšana.....	63
MĒRĪJUMU VEIKŠANA.....	63
Aproces uzlikšana	64
Mērišanas process	64
Mērišanas rezultātu nolasīšana.....	65
Mērījumu pārtraukšana.....	65
FUNKCIJA «ATMINA»	66
Saglabāto vērtību pārskatīšana.....	66
Visu mērījumu nodzēšana	66
BOJĀJUMU NOVĒRŠANA	67
UZGLABĀŠANA UN KOPŠANA.....	68
APRAKSTS UN SIMBOLI.....	69
TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS	70
GARANTIJA.....	71


KAS IR JĀZINA PAR ARTERIĀLO SPIEDIENU

Kas ir arteriālais spiediens?

Arteriālais spiediens - tas ir asins spiediens uz artēriju sieniņām. Arteriālais spiediens (AS) ir nepieciešams, lai nodrošinātu pastāvīgu asins cirkulāciju organismā. Pa teicoties arteriālajam asinsspiedienam, organisma šūnas tiek apgādātas ar skābekli, kurš nodrošina normālu to funkcionēšanu. «Sūkņa», kurš asinis iesūknē asinsvados, funkcijas pilda sirds. Katrs sirdspuksts nodrošina noteiktu AS līmeni. Izšķir divus AS veidus: sistoliskais (augšējais) asinsspiediens, kurš atbilst sirds saraušanās momentam, kurā notiek asinu iesūknēšana artērijās; diastoliskais (apakšējais) asinsspiediens - spiediens, kurš atbilst asinsspiedienam starp divām sirds saraušanās reizēm.



Cilvēka arteriālā asinsspiediena diennakts ritms

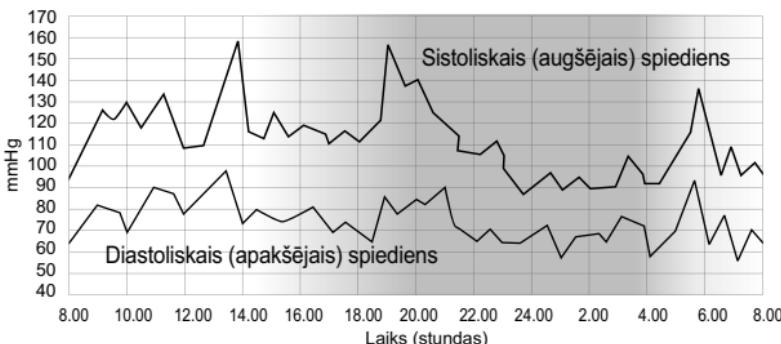

Arteriālā spiediena palielināšanās palielina sirds noslodzi, atstāj iespaidu uz asinsvadiem, padarot to sieniņas biezākas un mazāk elastīgas. Viens no hipertonijas rādītājiem ir tas, ka sākumā hipertonija var noritēt pašam pacientam nemanāmā veidā. Tieši tādēļ AS paškontrolei ir tik būtiska

loma. Slimībai progresējot parādās galvassāpes, pastāvīgi reiboni, paslik-tinās redze un dzīvībai svarīgu orgānu - galvas smadzeņu, sirds, nieru, asinsvadu funkcionēšanas traucējumi. Ja netiek pielietota atbilstoša terapija, iespējamas tādas paaugstināta arteriālā asinsspiediena sekas, kā nieru bojāumi, stenokardija, paralīze, runas spēju zaudēšana, vājprātība, miokarda infarkts un galvas smadzeņu insults.

Arteriālā spiediena normas

Arteriālā spiediena normu pasaules standarts ir Pasaules Veselības Organizācijas (PVO) Klasifikācija*:

AS kategorija	Sistoliskais AS (mmHg)	Diastoliskais AS (mmHg)
Hipotonija	< 100	< 60
Optimāls spiediens	100 - 119	60 - 79
Normāls spiediens	120 - 129	80 - 84
Augsts normāls spiediens	130 - 139	85 - 89
Mērena hipertonija	140 - 159	90 - 99
Vidēji smaga hipertonija	160 - 179	100 - 109
Smaga hipertonija	≥ 180	≥ 110

- * norādīta saīsinātā veidā.
- Ja diagnoze ir HIPERTONIJA, nepieciešama ārsta nozīmētās medikamentozās ārstēšanas un dzīvesveida korekcijas apvienošana.
- Augsta normāla un normāla AS gadījumā ieteicams veikt paškontroli, lai laicīgi būtu iespējams veikt AS samazināšanas līdz optimālam spiedienam pasākumus bez ārstniecības līdzekļu pielietošanas.
- Vecumā virs 50 gadiem sistoliskajam spiedienam (virs 140 mmHg) ir lielāka nozīme nekā diastoliskajam spiedienam.
- Pat normāla AS gadījumā hipertonijas palielināšanās risks ar vecumu palielinās.

UZMANĪBU

Ja miera stāvoklī izmērītie AS rādītāji nav neparasti, tomēr fiziskā un garīgā nomāktība uzrāda pārmērīgi paaugstinātus rezultātus, tas var norādīt uz labilo (t.s. nestabilo) hipertoniju. Ja Jums ir aizdomas par šādu parādību, ieteicams vērsties pie ārsta. Ja pie pareizi nomērīta asinsspiediena diastoliskais spiediens ir lielāks par 120 mmHg, nekavējoties ir jāizsauc ārsts.

MODEŁA M-200A AUTOMĀTISKĀ ARTERIĀLĀ SPIEDIENA MĒRĪTĀJA PRIEKŠROCĪBAS

Arteriālā spiediena līmeņa indikators

Spiediena līmeņa indikators ir izvietots gar kreiso displeja malu. Klasifikācija atbilst diapazonam, kas aprakstīts nodaļas «Arteriālā spiediena normas» tabulā. Pēc AS izmērišanas displeja kreisajā malā izgaismojas krāsaina punktota līnija: zaļa zona - optimāls spiediens, dzeltena - pa-augstināts, oranža - pārāk augsts, sarkana - pārāk augsts. Šī funkcija Jums ļauj patstāvīgi orientēties izmērītā AS rezultātos.

Sirds saraušanās biežuma traucējumu noteikšanas tehnoloģija (IHB)

Šī tehnoloģija ļauj noteikt neregulāru sirdsdarbību. Ja iekārtas displejā tiek parādīts IHB tehnoloģijas simbols , tas nozīmē, ka arteriālā spiediena mērišanas laikā iekārta ir konstatējusi sirds saraušanās biežuma traucējumus. Iespējams, ka kādā konkrētā gadījumā tādu rezultātu ir radījušas Jūsu parastā arteriālā spiediena izmaiņas, tādēļ vienkārši mērišanu atkārtojiet vēlreiz. Vairumā gadījumu nav iemesla uztraukties. Tomēr, ja simbols  parādās pastāvīgi (piemēram, vairākas reizes nedēļā ikdienas mērījumu gaitā), mēs iesakām Jums par šo faktu ziņot ārstam. Lūdzu savam ārstam parādīet sekojošu skaidrojumu:

Informācija medīķiem attiecībā uz sirdsdarbības ritma traucējumu noteikšanas (IHB) tehnoloģiju.

Šī iekārta ir oscilometriska arteriālā spiediena mērišanas iekārta ar pulsa biežuma noteikšanas vienlaicīgi ar mērījuma veikšanu funkciju. Iekārta ir klīniski apstiprināta. Pēc mērišanas beigām iekārtas displejā tiek parādīts IHB tehnoloģijas simbols , kas nozīmē, ka arteriālā spiediena mērišanas laikā iekārta ir konstatējusi sirds saraušanās biežuma traucējumus.

Ja simbols  parādās samērā bieži (piemēram, vairākas reizes nedēļā ikdienas mērījumu gaitā), mēs iesakām veikt medicīnisku apsekošanu.

Šī iekārta nekādā gadījumā neaizstāj kardioloģisku apsekošanu, tomēr tā agrīnā stadijā spēj konstatēt sirds saraušanās biežuma traucējumus.

SAGATAVOŠANĀS MĒRĪJUMIEM

Svarīga informācija

1. Izmantojiet ierīci TIKAI ievērojot šajā instrukcijā sniegtās norādes.
2. NEIZMANTOJIET aksesuārus, kurus nav norādījis ražotājs.
3. NEIZMANTOJIET ierīci, ja tā darbojas ar traucējumiem, vai ir bojāta.
4. NEZMANTOJIET ierīci vietās, kurās konstatēta aerosola izplūšana vai notiek skābekļa padeve.
5. Nekādā gadījumā NEIZMANTOJIET ierīci jaundzimušajiem vai maziem bērniem.
6. Šī ierīce NAV UZSKATĀMA par līdzekli jebkāda veida simptomu vai saslimšanas ārstēšanai. Mērījumu rezultāti paredzēti tikai informācijai. Pēc konsultācijām vērsieties pie ārsta.
7. Ierīci un elastīgo auklu NEDRĪKST novietot uz karstas virsmas.
8. NELIETOJIET manšeti citām ķermenē daļām, izņemot augšdelmu.
9. Lai paildzinātu ierīces kalpošanas laiku SVARĪGI ir to pareizi izmantot un periodiski veikt pārbaudes. Ja neesat pārliecināti par ierīces veikto mērījumu precizitāti, pārbaudiet ierīci vietējā servisa centrā.
10. Šī ierīce ir paredzēta personām, vecākām par 18 gadiem. Neizmantojiet ierīci, lai uzstādītu hipertonijas diagnozi un izmērītu arteriālo spiedienu jaundzimušajiem, maziem bērniem vai personām, kas tam nesniedz savu piekrišanu.
11. Ja Jums ir noteikta stipras aritmijas vai neregulāras sirdsdarbības, priekškambaru vai sirds kambaru ekstrasistoles, mirdzošās aritmijas diagnoze, mērījumu rezultātus, kas iegūti izmantojot šo ierīci, var no-vērtēt TIKAI ārsti.
12. NEIZMANTOJIET šo ierīci spēcīga elektromagnētiskā lauka avotu tu-vumā (piemēram, mobilā telefona, mikrovilņu krāsns), tas var traucēt ierīces darbībai.


SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU VISU IERĪCES LIETOŠANAS LAIKU

Komplektācija

M-200A modeļa automātiskais arteriālā spiediena mērītājs, M-L izmēra manšete (22 - 42 cm), AA baterijas 4 gab., adapteris, lietotāja instrukcija, garantijas talons, iepakojums.

Ārējais izskats un iekārtas apraksts

Attēlā ir parādīts modeļa M-200A automātiskais arteriālā spiediena mēriņtājs.

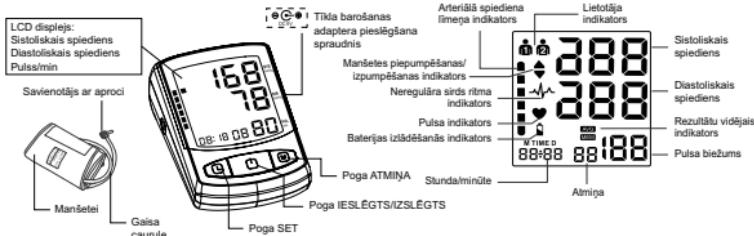

Komplektācija:



Instrukcija



Manšete



Adapteris


* Lietojiet tikai tirdzniecības markas tikla adapteri.

Bateriju uzstādīšana

1. Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu.
2. Ievietojiet baterijas, ievērojot polaritāti.
3. Aizveriet vāciņu. Izmantojiet tikai LR6, AA baterijas.

UZMANĪBU:

- Ja displejā tiek parādīts brīdināšanas simbols , tas nozīmē, ka baterijas ir praktiski izlādējušās. Pēc brīdināšanas simbola , parādīšanās displejā iekārtā nedarbīsies tik ilgi, kamēr būs veikta bateriju nomaiņa.
- Ja iekārtā ilgstoti netiek lietota, ieteicams no tās izņemt baterijas.
- Ieteicams lietot AA tipa baterijas (1,5 V).
- Uzlādējamos 1.2 V akumulatorus lietot nav ieteicams.
- Lai veiktu visu displeja elementu pārbaudi, turiet nospiestu ON/OFF (Iesl./Izsl.) pogu. Iekārtas normālas funkcionēšanas gadījumā tiks ie-slēgti visi simboli.

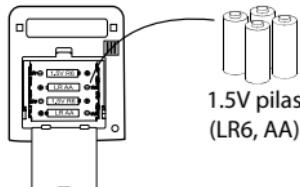


1.5V pilas (LR6, AA)

PIEZĪME: Bateriju resursu taupīšanas nolūkos iekārtā automātiski izslēgsies pēc 1 minūtes bezdarbības vai arī tad, kad tiks nospiesta ON/OFF (Iesl./Izsl.) poga.

Laika/datuma iestatīšana

Pateicoties ierīces funkcijai Laiks/datums, katra mērījuma rezultātu var saglabāt atmiņā kopā ar precīzu tā mērīšanas laiku.

1. Nospiediet ON/OFF (lesl./izsl.) pogu, lai ieslēgtu ierīci.
2. Pieskarieties pogai «» un paturiet līdz uz displeja, parādās mirgojošs gada apzīmējums.
3. Pēc tam nospiediet «M», izvēlēties nepieciešamo vērtību.
4. Iestatiet mēneša, datumu, stundas un minūtes kā aprakstīts iepriekš.

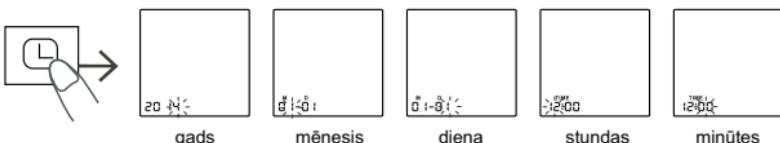

PIEZĪME

- Ja datums un laiks jāmaina, uz 3 sekundēm nospiediet pogu Laiks/datums, līdz sāk mirgot gada cipari. Pēc tam var ievadīt jaunās vērtības, ievērojot iepriekš sniegtās norādes.
- Ik reizi, nospiežot pogas Atmiņa un Laiks/datums, notiek viena darbība (piemēram, pārslēgšana uz nākamo iestatīšanas režīmu vai vērtības maiņa par +1).
- Turot nospiestu pogu, var paātrināt pāriešanu uz nepieciešamo režīmu vai nepieciešamā skaitļa meklēšanu.

Lietotāja izvēle

Šis arteriālā spiediena mēritājs saglabā atmiņā 30 mērījumu rezultātus katram no diviem lietotājiem. Pirms mērīšanas sākuma pārliecinieties, vai ierīce ir pārslēgta uz attiecīgo lietotāju

1. Pēc ierīces izslēgšanas nospiediet un paturiet pogu «SET», līdz ekrāna augšdaļas kreisajā stūrī sāk mirgot lietotāja simbols.
2. Nospiediet pogu «SET», lai pārslēgtu lietotāju.
3. Nospiediet pogu lesl./izsl., lai apstiprinātu lietotāja izvēli.

Tīkla barošanas adaptera pieslēgšana

Automātiskā arteriālā spiediena mēriņtāja M-200A konstrukcijā ir paredzēta tīkla adaptera pieslēgšana.

1. Adaptera spraudni ievietojiet ligzdā, kura atrodas iekārtas apakšējā daļā. Barošana no baterijām tiks automātiski atslēgta.
2. Pieslēdziet tīkla adapteri 220/110V barošanas avotam. Iekārta ir gatava darbam.
3. Iekārtas ieslēgšanu pārbaudiet nospiežot pogu lesl./lzs.




PIEZĪME:

- Lietojiet tikai tirdzniecības markas Dr. Frei tīkla adapteri. Ja tiek lietots jebkurš cits adapters, servisa centrs nav atbildīgs par iekārtas garantijas apkalpošanu.
- Kamēr iekārtai ir pieslēgts tīkla adapters, baterijas neizlādējas.
- Ja Jums ir jautājumi attiecībā uz iekārtas darbību no mainstrāvas tīkla, lūdzu vērsieties tirdzniecības organizācijā vai servisa centrā.

Manšetes pieslēgšana

Manšetes savienotāju ievietojiet tam paredzētajā ligzdā, kura atrodas iekārtas kreisajā pusē tā, kā tas ir parādīts attēlā.

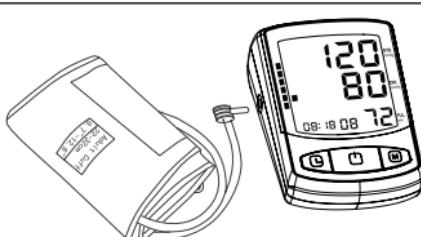

MĒRĪJUMU VEIKŠANA

UZMANĪBU

- Pirms mērījumu veikšanas vēlams kādu laiku pasēdēt mierīgā, atslābinātā stāvoklī.
- Katrs pacienta sasprindzinājums, piemēram, balstīšanās uz rokas, var palieināt asinsspiedienu. Pievērsiet uzmanību tam, lai ķermenis būtu patīkami atslābināts un mērīšanas laikā nesasprindzinet muskuļus tajā rokā, kurai veicat asinsspiediena mērīšanu.
- Spiedienu mēriet vienmēr vienai un tai pašai rokai (parasti kreisajai).

- Atbrīvojiet kreiso roku no apģērba. Neatrotiet piedurkni, jo tā saspiedīs Jūsu roku, kas radīs mērījuma neprecizitāti.
- Lietojiet tikai klīniski apstiprinātu oriģinālo aproci!
- Ja vēlaties veikt sava arteriālā spiediena uzskaiti, centieties mērījumus veikt vienā un tajā pašā laikā, jo arteriālais spiediens mainās atkarībā no diennakts laika.
- Lai mērījumi tiktu veikti korekti, atkārtotu mērījumu drīkst veikt tikai pēc 5 minūšu pārtraukuma.

Aproces uzlikšana

1. Pievienojiet manšeti ierīcei, ievietojot manšetes savienotāju ierīces manšetei paredzētajā ligzdā.
2. Iztaisnojiet un novietojiet kreiso (labo) roku sev priekšā ar plaukstu uz augšu. Artērijas iežīmei pie manšetes ir jābūt novietotai 2 - 3 cm augstāk virs locītavas, gaisa caurulītei - rokas iekšpusē.
3. Starp manšeti un roku ir jābūt nelielai starpai, tādai, lai tajā varētu ievietot divus pirkstus. Novelciet apģērbu, kas nosedz vai saspiež roku, kurai tiek veikts mērījums.
4. Ar salīpošo daļu cieši nostipriniet manšeti. Pārliecinieties, vai augšējā un apakšējā manšetes mala ir novietota vienādi.



Mērišanas process

Vienmēr ieslēdziet ierīci tikai tad, kad ir uzlikta manšete.

1. Nospiediet ON/OFF (iesl./Izsl.) pogu. Aptuveni 2 sekundes būs redzami visi displeja simboli, pēc tam displejā tiks parādīts simbols «0» vai pēdējā mērījuma rezultāts.




2. Tiks veikta automātiska manšetes piepumpēšana. Pulsa indikators «♥» mērījumu veikšanas laikā mirgo uz displeja. Pēc mērījuma, uz ekrāna parādās mērījuma rezultāts.



Mērišanas rezultātu nolasīšana

Dispļejā tiks parādītas arteriālā spiediena, pulsa vērtības un arteriālā spiediena līmenis pēc Pasaules Veselības organizācijas skalas. Simbola parādīšanās nozīmē to, ka iekārta ir konstatējusi sirds ritma traucējumus. Šis ir brīdinotīs signāls.

PIEZĪME: Ja šāds simbols parādās bieži, mēs iesakām vērsties pie ārsta (3-5 reizes nedēļā, katru dienu veicot mēriņumus). Atcerieties, ka mērišanas laikā ir svarīgi mierīgi sēdēt atslābinātā stāvokli un nesarunāties. Grafiskajā indikatorā tiek attēlots elements, kas rāda arteriālā spiediena līmeni pēc Pasaules Veselības organizācijas skalas.

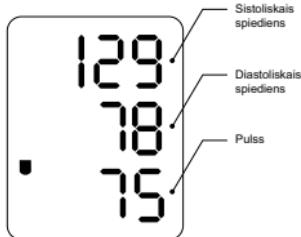

- Bīstami augsts arteriālais spiediens
- Loti augsts arteriālais spiediens
- Pārāk augsts arteriālais spiediens
- Nedaudz paaugstināts arteriālais spiediens
- Normāls arteriālais spiediens
- Optimāls arteriāls spiediens

Mēriju pārtraukšana

Ja kādu iemeslu dēļ ir jāpārtrauc mērišana (piemēram, sliktas pašsajūtas dēļ), nos piediet lesl./Izsl. pogu. Iekārta izslēgsies un no aproces izlaidīs gaisu.



FUNKCIJA «ATMIŅA»

Kad mērījums ir pabeigts, ierīce automātiski saglabā rezultātu kopā ar datumu un laiku. Ierīces atmiņa ir paredzēta 30 mērījumiem katram no diviem lietotājiem.

Saglabāto vērtību pārskatīšana

Pēc ierīces izslēgšanas nospiediet pogu Atmiņa. Displejā vispirms tiks attēlots **AVG** un pēc tam vidējā to trīs mērījumu vērtība, kas saglabāti pēdējo 10 minūšu laikā. Lūdzu, ievērojet: ja pēdējo 10 minūšu laikā atmiņā nav tikusi saglabāta neviena vērtība, displejā tiks attēlota vērtība «0»; ja atmiņā ir saglabāta tikai pēdējā vērtība, displejā tiks attēlota šī pēdējā vērtība; ja atmiņā ir saglabāti divi mērījumi, displejā tiek parādīta šo divu mērījumu vidējā vērtība. Turklat mērījumu rezultāti un vidējā vērtība atmiņā tiek saglabāta katram lietotājam atsevišķi. Pārskatot saglabātos mērījumus, pārliecinieties, vai ierīce ir pārslēgta uz attiecīgo lietotāju.

Vēlreiz nospiezot pogu Atmiņa, displejā ir redzams iepriekšējais rezultāts. Lai apskatītu konkrētu rezultātu, nospiediet un paturiet pogu Atmiņa, pārējot uz nepieciešamo rezultātu. Ja ierīce konstatē aritmiju, displejā papildus mērījuma rezultātam, datumam un laikam tiek parādīts  simbols.

PIEZĪME: Nav ieteicams veikt mērījumus tūlīt vienu pēc otra, jo tas izraisa rezultātu neprecizitāti. Pirms nākamā mērījuma dažas minūtes atpūties sēdus vai guļus stāvoklī.

Visu mērījumu nodzēšana

Pirms visu saglabāto mērījumu izdzēšanas no ierīces atmiņas pārliecinieties, vai tie turpmāk nebūs vajadzīgi. Nepieciešamības gadījumā rezultātus pierakstiet, jo par tiem, iespējams, būs jāinformē ārsts. Lai izdzēstu visus saglabātos mērījumus, nospiediet un paturiet pogu Atmiņa, līdz displejā ir redzams mirgojošs simbols «».

Atlaidiet pogu. Pēc tam, kamēr simbols «» mirgo, vēlreiz nospiediet pogu Atmiņa, lai pabeigtu darbību. Atsevišķus mērījumus izdzēst nav iespējams.



BOJĀJUMU NOVĒRŠANA

Ja veiciet norādītās darbības, bet klūda, kas nav norādīta zemāk dotajā tabulā, parādās no jauna, griezieties pēc palīdzības servisa centrā. Nekādā gadījumā nemēģiniet saviem spēkiem labot ierīci.

Paziņojums uz ekrāna	Iespējamie iemesli	Novēršana
Kad jūs nospiediet pogu ON/OFF uz ekrāna nekas nepārādās vai parādās mirgojošs simbols izlietotās baterijas 	Baterijas nav ievietotas	Ievietojiet baterijas
	Baterijas izsmeltas	Nomainiet baterijas pret jaunām
	Baterijas ievietotas nepareizi	Ievietojiet baterijas ar polaritāti
E1 Nav normāla manšetes piepumpēšana	Pārbaudiet manšetes hermētiskumu	Nomainiet jaunu manšeti
E3 Ierīces sūknis ie-pumpē aprocē pārāk augstu spiedienu		Veiciet atkārtotu mērījumu vai griezieties servisa centrā lai veiktu pārbaudi
E2 E4 Mērījuma laikā tika kustināta roka vai ķermenis	Mērījuma laikā tika kustināta roka vai ķermenis	Nepārvietojaties mērījuma laikā un atkārtoti veiciet mērījumu
 Bateriju simbols	Baterijas izlādēšanās	Nomainiet baterijas un atkārtoti veiciet mērījumu
Sistoliskais vai diastoliskais asinsspieiens ir pārāk augsts	Manšete atradusies zemāk par sirds līmeni	Ienemiet pareizu stāvokli un atkārtoti veiciet mērījumu
	Manšete uzlikta nepareizi	
	Jūs pārvietojāties vai runājāt mērījuma laikā	
Sistoliskais vai diastoliskais asinsspieiens ir pārāk zems	Manšete atradusies augstāk par sirds līmeni	Ienemiet pareizu stāvokli un atkārtoti veiciet mērījumu
	Jūs pārvietojāties vai runājāt mērījuma laikā	

UZMANĪBU

Ja arteriālā spiediena mērītājam ir radušies tehniska rakstura darbības traucējumi, vērsieties tirdzniecības vietā, kurā iegādājieties iekārtu vai arī Dr. Frei® servisa centrā. Nekādā gadījumā nemēģiniet patstāvīgi veikti ie-kārtas remontu. Ja iekārta būs patvalīgi atvērta, garantija nebūs spēkā.

PIEZĪME: Arteriālā spiediena līmenis dienas laikā var svārstīties arī veseliem cilvēkiem. Pievērsiet uzmanību tam, ka, lai būtu iespējams salīdzināt mērījumu rezultātus, tie ir jāveic aptuveni vienā un tajā pašā diennakts laikā (miera stāvoklī)! Ja, neskatoties uz to, ka ie-vērojat visus augstāk minētos norādījumus, spiediena svārstības ir lielākas par 15 mmHg un/vai Jūs dzirdat neregulārus pulsa sitienus, vērsieties pie ārsta.

UZGLABĀŠANA UN KOPŠANA

<p>Spiediena mērītāju glabājiet sausā vietā, kura ir aizsargāta pret pārāk augstu/zemu temperatūru, putekļu un tiešu saules ietekmi.</p>	
<p>Lai nesabojātu jūtīgo ieliktni, aproci nedrīkst savērpt vai nolocīt.</p>	
<p>Mērītāja tīrīšanai lietojiet maigu, sausu auduma lupatiņu. Nelietojiet benzīnu, šķīdinātājus vai tamlīdzīgus līdzekļus. Traipus no aproces tīriet ar ziepju šķidumā samitrinātu lupatiņu. Aproci nedrīkst mazgāt!</p>	

Ar savienojošo caurulīti rīkojieties uzmanīgi. Aprocī un gumijas caurulītes sargiet no asiem priekšmetiem.



Mērītāju nedrīkst nomest vai lietot spēku tā lietošanā.



Nekad neatveriet iekārtu! Pretējā gadījumā tiks izjaukta rūpničā veiktā kalibrēšana.



APRAKSTS UN SIMBOLI

SIMBOLI	APRAKSTS
	Skatiet lietotāja instrukciju
	Ražotājs
	Sērijas numurs
	Uzmanību, skatiet pavaddokumentus
	Utilizējiet saskaņā ar Jūsu valsts likumdošanu
	BF tipa aprīkojums
	Aizsardzības klase II
	CE markējums

Iekārtas periodiskā kalibrēšana

Mēriekārtu precizitāte ik pēc noteikta laika ir jāpārbauda. Tādēļ periodiski divas reizes gadā ieteicams pārbaudīt statiskā spiediena indikāciju. Datalīzētu informāciju Jūs varat saņemt Dr. Frei® servisa centrā.

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

Mēriju metode	Oscilometriskā
Indikācija	Šķidro kristālu displejs
Mēriju diapazons:	Spiediens: 30 - 280 mmHg Pulss: 40 - 199 sitiens/minūtē
Mēriju precizitāte:	Spiediens: ± 3 mmHg Pulss: $\pm 5\%$
Atmiņas:	30 mēriju rezultāti katram lietotājam
Barošana:	4 tipa (AA, LR6) 1,5 V baterijas
Darba temperatūras diapazons	+5 - +40 °C, pie relatīvā mitruma: 15% - 93%, atmosfēras spiediens: 70 kPa - 106 kPa
Glabāšanas temperatūra:	-20 - +55 °C, pie relatīvā mitruma: 0% - 93%, atmosfēras spiediens: 50 kPa - 106 kPa
Ierīces izmēri:	135 (garums) x 90 (platums) x 62 (augstums) mm
Svars:	380 g bez baterijām
Manšetes izmērs	22 - 42 cm
Klasifikācija	BF tipa
Strāvas adapteris	Ieeja: 100 - 240 V, ~50/60 Hz, 0.2 A Izeja: 6 V ___ 500 mA

* Iespējamas tehniskas izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma!

GARANTIJA

Automātisksā arteriālā spiediena mērītāja M-200A garantija ir 5 gadi no iegādes dienas. 1 gada garantija tiek nodrošināta aprocei no pirkuma veikšanas dienas. Garantija nav spēkā bojājumu gadījumos, kuri radušies nepareizas lietošanas, nelaimes gadījumu, lietotāja instrukcijas neievērošanas gadījumos, kā arī iekārtas patstāvīgas atvēršanas un/vai remontēšanas gadījumos. Garantija ir spēkā tikai tad, ja servisa centrā tiek uzrādīts pareizi aizpildīts garantijas talons ar tirdzniecības uzņēmuma zīmogu.

STIMATE UTILIZATOR AL TENSIOMETRULUI AUTOMAT DR. FREI

Vă mulțumim că ați ales tensiometrul automat **Dr. Frei®**. Suntem siguri că apreciind la justa valoare calitatea și siguranța oferită de acest aparat, veți deveni utilizator permanent al produselor mărcii comerciale elvețiene **Dr. Frei®**.

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunea. În ea veți găsi toată informația necesară pentru măsurarea corectă a tensiunii arteriale și a pulsului. Pentru toate întrebările referitoare la acest produs vă rugăm să consultați reprezentantul oficial sau să vă adresați la centrul de deservire TM **Dr. Frei®** din țara Dvs.

ATENȚIE!

Acest tensiometru este destinat pentru măsurarea independentă a tensiunii arteriale, dar nu pentru diagnosticarea hipertensiunii/hipotensiunii. În nici un caz nu stabiliți diagnoze în baza rezultatelor obținute în urma măsurării tensiunii arteriale. Nu vă auto-tratați și nu schimbați metodele de tratament fără a consulta în prealabil medicul.



Clasa de protecție BF.




Înainte de utilizarea acestui aparat citiți cu atenție instrucțiunea.

CE ESTE NECESAR SĂ ȘTIȚI DESPRE	
TENSIUNEA ARTERIALĂ?	74
Ce este tensiunea arterială?	74
Valorile tensiunii arteriale.....	75
AVANTAJELE TENSIOMETRULUI AUTOMAT MODEL M-200A	76
Indicator al nivelului de tensiune arterială	76
Tehnologia de depistare a tulburărilor de ritm cardiac (IHB)	76
PREGĂTIREA PENTRU MĂSURARE	77
Informații importante.....	77
Piese componente.....	77
Aspectul extern și descrierea aparatului.....	78
Instalarea bateriilor	78
Setarea orei și zilei	79
Alegerea utilizatorului	79
Conecțarea adaptorului la rețea	80
Conecțarea manșetei	80
EFFECTUAREA MĂSURĂRII.....	80
Aplicarea manșetei	81
Procesul măsurării.....	81
Citirea rezultatelor măsurării.....	82
Întreruperea măsurării	82
FUNCTIA «MEMORIE».....	83
Vizualizarea valorilor stocate	83
Stergerea tuturor valorilor	83
ÎNLĂTURAREA DEFECȚIUNILOR.....	84
PĂSTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA	85
DESCREREA SIMBOLURILOR	86
CARACTERISTICI TEHNICE.....	87
GARANȚIE.....	88


CE ESTE NECESAR SĂ ȘTIȚI DESPRE TENSIUNEA ARTERIALĂ?

Ce este tensiunea arterială?

Tensiunea arterială este tensiunea săngelui exercitată pe peretii arterelor. Tensiunea arterială (TA) este necesară pentru asigurarea circulației permanente a săngelui. Datorită acesteia, celulele organismului primesc oxigen, care, la rândul lui, asigură buna funcționare a acestora. Inima, care acționează ca o pompă, împinge sângele în vase. Fiecare bătaie a inimii asigură un anumit nivel al TA. Se deosebesc 2 tipuri de TA: sistolică (superioară), care presupune contracția inimii; și diastolică (inferioară), care corespunde presiunii săngelui între două contracții ale inimii.

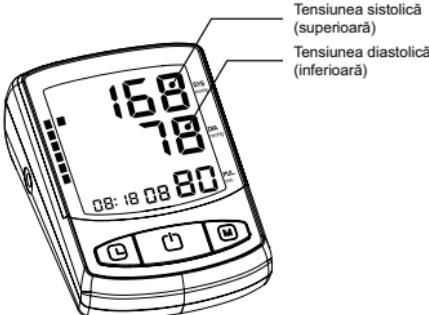

Ritmul circadian al tensiunii arteriale la om

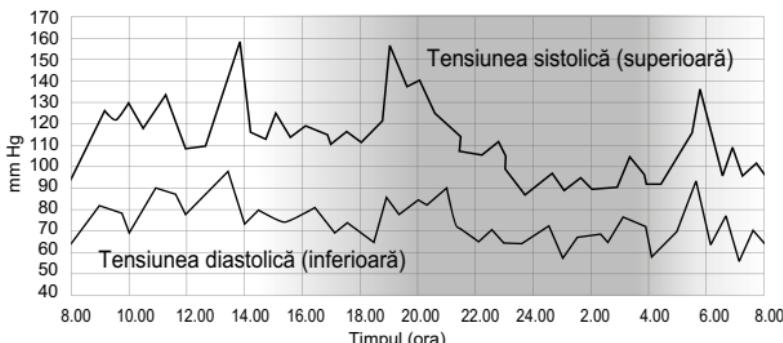

Cresterea tensiunii arteriale sporește presiunea asupra inimii și acționează asupra vaselor sanguine, făcând pereții acestora mai groși și mai puțin elastic. Una dintre particularitățile hipertensiunii este faptul că la etapa inițială aceasta poate decurge fără simptome. Anume din această cauză auto-controlul TA are un rol foarte important. Odată cu progresarea bolii,

apar dureri de cap, amețeli permanente, se înrăutățește vederea și funcționarea organelor vitale – creierul, inima, rinichii, vasele sangvine.

În lipsa unei terapii corespunzătoare sunt posibile astfel de consecințe ale tensiunii arteriale crescute, precum afectarea rinichilor, stenocardie, paralizie, pierderea capacității de a vorbi, deficiență mintală, infarct miocardic și accident vascular cerebral.

Valorile tensiunii arteriale

Drept standard mondial al valorilor tensiunii arteriale servește Clasificarea* Organizației Mondiale a Sănătății (OMS):

Gamă TA	Tensiunea sistolică (mmHg)	Tensiunea diastolică (mmHg)
Tensiune arterială prea joasă	< 100	< 60
Tensiune arterială optimă	100 - 119	60 - 79
Tensiune arterială normală	120 - 129	80 - 84
Tensiune arterială ușor crescută	130 - 139	85 - 89
Tensiune arterială prea înaltă	140 - 159	90 - 99
Tensiune arterială extrem de înaltă	160 - 179	100 - 109
Tensiune arterială periculos de înaltă	≥ 180	≥ 110

* este indicată cu abrevieri.

- În cazul diagnosticării hipertensiunii, este necesar să combinați tratamentul medicamentos prescris de către medic cu modul sănătos de viață.
- În cazul unei TA normale și înalt normale este recomandat autocontrolul, cu scopul de a întreprinde la timp măsuri de scădere a TA până la un nivel optim, fără administrarea preparatelor medicamentoase.
- La vârsta de peste 50 de ani tensiunea sistolică înaltă (peste 140 mmHg) joacă un rol mai important decât tensiunea diastolică.
- Chiar și în cazul unei TA normale, riscul dezvoltării hipertensiunii crește odată cu vârsta.

ATENȚIE!

Dacă valorile TA măsurate în stare de repaus sunt obișnuite, deși în cazul efortului fizic sau a oboseilii mentale observați rezultate mult mai înalte, să știți că acesta poate fi un indiciu al așa-numitei hipertensiuni labile (adică

instabile). Dacă aveți suspiciuni că suferiți de acest tip de hipertensiune, vă recomandăm să consultați medicul.

Dacă în cazul măsurării corecte a tensiunii arteriale tensiunea diastolică este de peste 120 mmHg, este necesar să chemați de urgență medicul.

AVANTAJELE TENSIOMETRULUI AUTOMAT MODEL M-200A

Indicator al nivelului de tensiune arterială

Indicatorul nivelului de tensiune arterială este amplasat de-a lungul ecranului în partea stângă. Clasificarea corespunde domeniilor descrise în tabelul de la compartimentul «Valorile tensiunii arteriale». După măsurarea tensiunii arteriale o linie color punctată se va afișa în partea stângă a ecranului: culoarea verde - tensiune optimă, galbenă - ridicată, portocalie - foarte înaltă, roșie - periculos de înaltă. Această funcție vă va ajuta să evaluați de sine-stătător rezultatul obținut în urma măsurării.

Tehnologia de depistare a tulburărilor de ritm cardiac (IHB)

Această tehnologie permite să fie depistate bătaile neregulate ale inimii. Dacă pe ecranul aparatului apare simbolul tehnologiei IHB , înseamnă că în procesul măsurării tensiunii arteriale aparatul a depistat anumite tulburări de ritm cardiac. Este posibil ca într-un caz concret un astfel de rezultat să fie condiționat de schimbarea tensiunii arteriale pe care o aveți de obicei, de aceea repetăți măsurarea. În majoritatea cazurilor nu sunt motive de îngrijorare. Cu toate acestea, dacă simbolul  apare în permanentă (de exemplu, de câteva ori pe săptămână atunci când vă măsuраți tensiunea arterială în fiecare zi), vă recomandăm să consultați medicul. Vă rugăm să arătați medicului dvs. această explicație:

Informație pentru medici referitoare la tehnologia de depistare a tulburărilor de ritm cardiac (IHB)

Acest aparat reprezintă un dispozitiv de măsurare oscilometrică a tensiunii arteriale, cu funcție de analiză a ritmului cardiac în procesul măsurării. Aparatul a fost aprobat clinic. La sfârșitul măsurării, pe ecranul aparatului va apărea simbolul tehnologiei IHB  în cazul în care în procesul de măsurare a tensiunii arteriale aparatul a depistat tulburări de ritm cardiac. Dacă simbolul  apare destul de des (de exemplu, de câteva ori pe

săptămână atunci când vă măsurați tensiunea arterială în fiecare zi), vă recomandăm să consultați medicul.

Acest aparat nu înlocuiește nicidecum examenul cardiologic. Cu toate acestea, el permite să fie depistate tulburările de ritm cardiac într-un stadiu incipient.

PREGĂTIREA PENTRU MĂSURARE

Informații importante

1. Utilizați aparatul doar în scopurile descrise în această instrucțiune.
2. Nu folosiți accesorii care nu sunt indicate de către producător.
3. Nu folosiți aparatul dacă funcționează prost sau este deteriorat.
4. Nu folosiți aparatul în locuri în care are loc pulverizare de aerosoli sau furnizare de oxigen.
5. Nu folosiți nicidcum aparatul pentru copii mici sau nou-născuți.
6. Acest aparat nu este un mijloc de tratament a unor simptome sau boli. Rezultatele măsurărilor servesc doar pentru informare. Adresați-vă medicului pentru un consult.
7. Nu păstrați aparatul și cablul acestuia în apropierea suprafetelor fierbinți.
8. Nu aplicați manșeta pe alte zone ale corpului în afara de braț.
9. Este foarte important să utilizați corect aparatul și să-l verificați periodic pentru prelungirea termenului de funcționare a acestuia. Dacă nu sunteți siguri de exactitatea rezultatelor obținute adresați-vă la centrul de deservire.
10. Acest aparat este destinat persoanelor cu vârstă mai mare de 18 ani.
11. Nu utilizați aparatul pentru diagnosticarea hipertensiunii și pentru măsurarea tensiunii arteriale la nou născuți, copii mici.
12. Rezultatele măsurării obținute prin utilizarea acestui aparat trebuie să fie evaluate doar de către medic, dacă vi s-a pus diagnostic de aritmie severă, bătăi neregulate ale inimii sau fibrilație atrială.


PĂSTRAȚI ACEASTĂ INSTRUCȚIUNE PE TOT PARCURSUL PERIOADEI DE UTILIZARE

Piese componente

Setul include tensiometrul automat M-200A, manșetă de dimensiunea M (22 - 42 cm), 4 baterii AA, adaptorul de rețea, manual de utilizare, certificat de garanție, ambalaj.

Aspectul extern și descrierea aparatului

Pe imagine este prezentat tensiometrul automat M-200A.

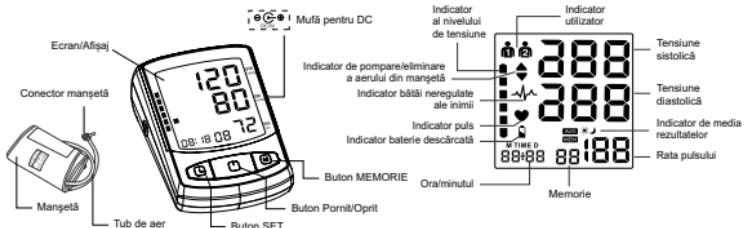

Setul include:




* Folosiți doar adaptorul mărcii comerciale Dr.Frei®.

Instalarea bateriilor

- Scoateți capacul compartimentului pentru baterii (vedeți imaginea).
- Puneți baterii, respectând polaritatea.
- Închideți capacul de protecție. Folosiți doar baterii alcaline de tip LR6, AA.

ATENȚIE!


- Dacă pe ecran va apărea un simbol de avertizare, înseamnă că bateriile sunt practic descărcate. După apariția simbolului de avertizare aparatul nu va mai funcționa până vor fi înlocuite bateriile.
- Dacă aparatul nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp, vă recomandăm să scoateți bateriile din acesta.
- Vă recomandăm să folosiți baterii de tip AA (1,5 V). Nu se recomandă folosirea acumulatoarelor încărcabile.
- Pentru a verifica toate elementele ecranului țineți apăsat butonul ON/OFF. În cazul în care tensiometrul funcționează în mod normal, pe ecran vor apărea toate elementele corespunzătoare.



Setarea orei și zilei

Datorită funcției «Ora/Data», la fiecare măsurare a tensiunii arteriale aparatul poate reține în memorie rezultatul măsurării împreună cu ora exactă la care aceasta a fost efectuată.

1. Apăsați butonul «» pentru a porni aparatul.
2. Apăsați și țineți apăsat butonul «» până va clipească pe ecran «Anul».
3. Apoi, apăsând butonul «M» selectați valoarea dorită. Confirmați selecțarea apăsând butonul «».
4. Exact în același mod, introduceți luna, ziua, ora, minutul.



REMARĂ:

- Dacă doriti să setați data și ora, țineți apăsat timp de 3 secunde butonul Ora/Data, până cifrele vor începe să clipească. Apoi puteți introduce modificările, urmând pașii de mai sus.
- La fiecare apăsare a butoanelor Memorie și Ora/Data va avea loc o operațiune (de exemplu, trecerea la următorul regim de setare sau modificare a valorilor cu +1)
- Dacă țineți butonul apăsat puteți accelera trecerea la alt regim sau căutarea cifrei necesare.

Alegerea utilizatorului

Acest tensiometru păstrează în memorie 30 de rezultate ale măsurărilor efectuate separat de doi utilizatori. Înainte de a începe măsurarea, asigurați-vă că ați ales utilizatorul necesar.

1. Atunci când aparatul este conectat, țineți apăsat butonul «SET» până va începe să clipească simbolul utilizatorului din colțul de sus din stânga ecranului.
2. Apăsați butonul «SET» pentru a alege utilizatorul.
3. Apăsați butonul ON/OFF pentru a confirma alegerea utilizatorului.



Conecțarea adaptorului la rețea

Construcția tensiometrului automat M-200A prevede posibilitatea conexiunii adaptorului la rețea.

1. Conectați ștecărul adaptorului la mufa amplasată în partea de jos a aparatului. Alimentarea aparatului în baza bateriilor se va opri în mod automat.
2. Conectați adaptorul la o sursă de alimentare de 220/110 W. Aparatul este gata pentru a fi folosit.
3. Verificați dacă aparatul este conectat apăsând butonul ON/OFF.




REMARCA:

- Folosiți doar adaptorul mărcii comerciale Dr. Frei. În cazul în care folosiți orice alt adaptor, centrul de deservire nu-și asumă nici o obligație de a deservi aparatul în bază de garanție.
- Bateriile nu se consumă atunci când adaptorul pentru curent alternativ este conectat la aparat.
- Vă rugăm să vă adresați la un centru de deservire dacă aveți întrebări referitoare la utilizarea dispozitivului pentru curent alternativ.

Conecțarea manșetei

Introduceți conectorul manșetei în mufa amplasată pe partea stângă a aparatului, după cum este indicat în imagine.

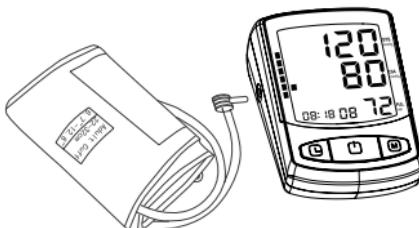

EFFECTUAREA MĂSURĂRII

ATENȚIE!

- Înainte de măsurare este preferabil să stați puțin într-o stare de calm și relaxare.
- Fiecare efort al pacientului, de exemplu, sprijinirea cu mâna, poate duce la creșterea tensiunii arteriale. Aveți grijă ca corpul să fie relaxat și

nu încordați mușchii de la mâna la care efectuați măsurarea.

- Măsurați întotdeauna tensiunea arterială la aceeași mână (de obicei - stânga).
- Eliberați mâna stângă de haine. Nu suflecați mâncea, deoarece aceasta va presa mâna Dvs. și poate rezulta o măsurare inexactă.
- Folosiți doar manșeta originală aprobată clinic!
- Dacă vreți să duceți o evidență a tensiunii arteriale, străduiți-vă să efectuați măsurările la aceeași oră, întrucât tensiunea arterială se schimbă în dependență de perioada zilei.
- Pentru ca măsurările să fie corecte, efectuați o măsurare repetată doar după 5 minute de pauză.

Aplicarea manșetei

1. Conectați manșeta la aparat, introducând conectorul manșetei la mufa din partea stângă a aparatului.
2. Punetă mâna pe masă cu palma în sus. Fixați manșeta mai sus de cot. Marginea inferioară a manșetei trebuie să fie aplicată cu 2 - 3 cm mai sus de plica cotului, tubul de cauciuc - în partea inferioară a antebrațului.
3. Între manșetă și braț trebuie să lăsați spațiu liber, astfel încât să pătrundă 2 degete. Scoateți orice haină care acoperă sau strînge brațul pe care efectuați măsurarea.
4. Fixați manșeta cu ajutorul Velcro-ului fără să o strîngeți prea tare. Asigurați-vă ca partea superioară și inferioară a manșetei nu să intre.




Procesul măsurării

Întotdeauna porniți aparatul cînd este deja aplicată manșeta.

1. Apăsați butonul ON/OFF. În decurs de 2 secunde, pe ecran vor apărea toate simbolurile, după care va intra în funcție regimul de măsurare și pe ecran va apărea «0» sau rezultatul ultimei măsurări.



2. Manșeta se va umfla automat. Pe ecran va încărni indicatorul «♥». După terminarea măsurării, rezultatul va apărea pe ecran.

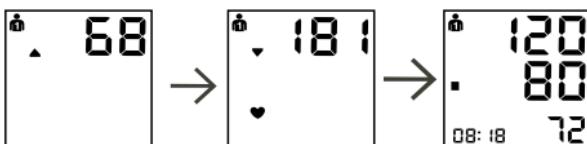


Citirea rezultatelor măsurării

Semnalul sonor lung însoțește sfârșitul măsurării. Pe ecran vor fi afișate valorile tensiunii arteriale, pulsului și tensiunii arteriale pe scara Organizației Mondiale Sănătății. Apariția simbolului înseamnă că aparatul a depistat tulburări de ritm cardiac. Acest indicator servește drept avertizare.

REMARCA: Dacă un astfel de simbol apare frecvent (de 3-5 ori pe săptămână, în cazul măsurărilor zilnice), vă recomandăm să consultați medicul. Nu uitați că în procesul măsurării este important să fiți calm, în poziție relaxată și să nu vorbiți.

Pe indicatorul grafic va fi afișat elementul care indică nivelul tensiunii arteriale pe scara Organizației Mondiale Sănătății.

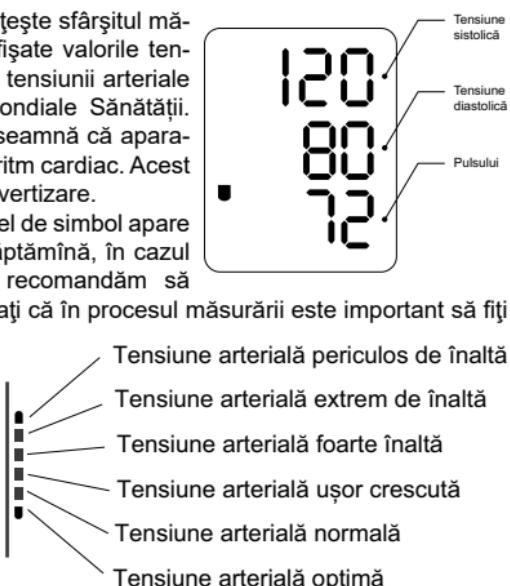

Întreruperea măsurării

Dacă, dintr-un anumit motiv, trebuie să întrerupeți procesul măsurării (de exemplu, vă simțiți rău), apăsați butonul ON/OFF. Aparatul se va opri și eliberați aerul din manșetă.



FUNCȚIA «MEMORIE»

După terminarea măsurării, dispozitivul stochează în mod automat rezultatul cu data și ora. Memoria dispozitivului este de 30 de măsurători pentru fiecare dintre cei 2 utilizatori.

Vizualizarea valorilor stocate

Atunci când aparatul este deconectat, apăsați butonul Memorie. Pe ecran se va afișa **AVG**, după care apare valoarea care reprezintă media ultimelor trei măsurări din memorie în timp de 10 minute.


Atenție: Dacă în memorie nu sunt valori, atunci pe parcursul a 10 minute pe ecran se va afișa «0»; dacă în memorie este stocată doar ultima valoare măsurată, atunci pe ecran se va afișa această valoare; dacă în memorie sunt păstrate două rezultate, pe ecran va fi afișată valoarea medie a celor două măsurări. În același timp, rezultatele măsurărilor și valoarea medie a acestora se vor păstra în memorie separat pentru fiecare utilizator. Atunci când vizualizați valorile salvate, asigurați-vă că ați ales în prealabil utilizatorul necesar. Apăsând iarăși butonul Memorie, pe ecran va fi afișat rezultatul anterior.

Pentru a vizualiza un anumit rezultat, țineți apăsat butonul Memorie, pentru a trece la rezultatul necesar. Dacă aparatul a detectat aritmie, pe ecran va fi afișat simbolul corespunzător, în afară de rezultatul măsurării, ora și data.

REMARCA: Nu se recomandă să efectuați măsurările imediat una după alta, căci ați putea obține valori incorecte. Faceți o pauză de câteva minute, în poziție aşezat sau culcat, înainte de a efectua următoarea măsurare.

Ștergerea tuturor valorilor

Înainte de a șterge toate rezultatele salvate din memoria aparatului, asigurați-vă că nu veți mai avea nevoie de acestea pe viitor. În caz de nevoie, notați rezultatele măsurărilor pentru cazul în care va trebui să le prezentați medicului. Pentru a șterge toate valorile salvate, țineți apăsat butonul Memorie, până pe ecran va apărea simbolul «» care va clipea. Lăsați butonul. După aceasta apăsați încă o dată butonul Memorie în timp ce clipește simbolul «», pentru a finaliza operațiunea. Ștergerea unor rezultate aparte nu este posibilă.

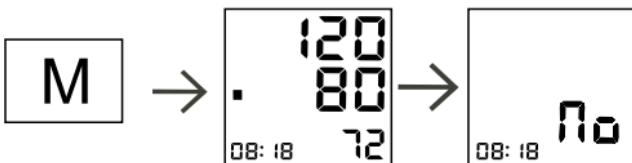

ÎNLĂTURAREA DEFECȚIUNILOR

Dacă în procesul utilizării apar neregularități care nu sunt indicate în tabelul de mai jos, adresați-vă unui centru de deservire. Nici într-un caz nu încercați să reparați desinestătător aparatul.

Mesaj pe ecran	Cauza posibilă	Soluționare
Când apăsați butonul ON/OFF, pe ecran nu apare nimic sau apare un simbol intermitent al bateriilor descărcate ☐.	Nu sunt introduse bateriile	Introduceți bateriile
	Bateriile s-au epuizat	Înlocuiți bateriile cu cele noi
	Polaritatea bateriilor este inversată	Introduceți bateriile respectând polaritatea
E1 Manșeta nu se umflă cum trebuie	Asigurați-vă că manșeta este ermetică	Schimbați manșeta cu alta nouă
E3 Presiunea din manșetă este prea mare		Măsurăți încă o dată tensiunea sau trimiteți dispozitivul la centrul de deservire tehnică pentru a fi verificat
E2 E4 Mâna s-a mișcat în timpul măsurării	Mâna sau corpul s-au mișcat în timpul măsurării	Nu vă mișcați în timpul măsurării și repetați măsurarea
☒ Simbolul bateriei	Bateria are prea puțină energie	Schimbați bateriile și repetați măsurarea

Indicele tensiunii sistolice sau diastolice este prea înalt	Manșeta a fost fixată mai jos de nivelul inimii	Respectați poziția corectă și repetați măsurarea
	Manșeta a fost îmbrăcată greșit	
	V-ați mișcat sau ați vorbit în timpul măsurării	
Indicele tensiunii sistolice sau diastolice este prea scăzut	Manșeta a fost fixată mai jos de nivelul inimii	
	V-ați mișcat sau ați vorbit în timpul măsurării	

ATENȚIE!

Dacă tensiometrul are defecțiuni tehnice, adresați-vă celor de unde ați achiziționat aparatul sau la un centru de deservire. Nu încercați nici într-un caz să reparați Dvs. aparatul! În cazul în care dezasamblați de sine stătător aparatul, garanția își pierde valoarea.

REMARCA: Nivelul tensiunii arteriale are proprietatea de a devia pe parcursul zilei chiar și la persoanele sănătoase. Rețineți că pentru a putea compara rezultatele măsurărilor, acestea trebuie să fie efectuate aproximativ la aceeași oră și în aceleași condiții (în stare de calm)! Dacă ați respectat toate cerințele sus-indicate, iar devierile tensiunii continuă să fie de peste 15 mmHg și/sau auziți în mai multe rânduri bătăi neregulate ale inimii, consultați medicul.

PĂSTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Păstrați tensiometrul într-un loc uscat, protejat de acțiunea temperaturilor prea înalte sau prea joase, precum și împotriva prafului și a razelor solare directe.



Nu răsuciți și nu stoarceți manșeta, pentru a nu deteriora insertia delicată din interiorul acesteia.	
Pentru a curăța tensiometrul folosiți o cârpă moale curată. Nu folosiți benzинă, dizolvant sau alte soluții asemănătoare. Petele de pe manșetă înlăturați-le cu grijă cu ajutorul unei cârpe înmiate într-o soluție de săpun. Nu spălați manșeta!	
Mânuiați cu atenție tubul de aer pentru conectare. Evitați contactul manșetei și tubului de aer cu obiectele ascuțite.	
Nu scăpați jos și nu aplicați forță la utilizarea tensiometrului.	
Nu dezasamblați niciodată aparatul! În caz contrar veți deregla calibrarea din fabrică a acestuia.	

DESCRIEREA SIMBOLURILOR

SIMBOL	DESCRIEREA
	Vedeți instrucțiunea
	Producător

[SN]	Număr de serie
	Atenție, vedeți documentele de însoțire
	Utilizați în conformitate cu cerințele din țara dumneavoastră
	Aparat tip BF
	Clasa de protecție II
 0413	Marcaj CE

Calibrarea periodică a aparatului

Exactitatea aparatelor de măsură trebuie să fie verificată la anumite perioade de timp. Din acest motiv se recomandă să verificați periodic, adică o dată la doi ani, indicațiile tensiunii statice. Informații mai detaliate puteți primi adresându-vă la un centru de deservire.

CARACTERISTICI TEHNICE

Metoda de măsurare	Oscilometrică
Afișaj	LCD Ecran
Domeniu de măsurare:	Presiune: 30 - 280 mmHg Pulsul: 40 - 199 bătăi/minut
Precizie:	Presiune: ± 3 mmHg Pulsul: $\pm 5\%$
Memorie:	Cîte 30 de măsurări pentru 2 utilizatori
Sursa de alimentare:	Baterii 4 x 1,5 V (LR6 sau AA)
Domeniul temperaturilor de funcționare:	+5 - +40 °C, umiditate relativă: 15% - 93%, presiunea atmosferică: 70 kPa - 106 kPa

Mediu de păstrare:	-20 - +55 °C, umiditate relativă: 0% - 93%, presiunea atmosferică: 50 kPa - 106 kPa
Dimensiuni aparat:	135 (L) x 90 (l) x 62 (H) mm
Greutate:	380 g fără baterii
Dimensiuni manșetă	22 - 42 cm
Clasificarea	Tip BF
Adaptor rețea	Intrare: 100 - 240 V, ~50/60 Hz, 0.2 A Ieșire: 6 V ___ 500 mA

* Sunt posibile modificări tehnice fără preaviz.

GARANȚIE

Pentru tensiometrul automat M-200A este oferită o garanție de 5 ani din ziua achiziționării. Garanția dată nu se răsfrângе pentru: manșetă, adaptor și alte accesorii, pentru manșetă garanția este de 1 an de la data procurării, pentru utilizarea în uz casnic. Garanția nu este valabilă pentru defecțiunile apărute în rezultatul exploatarii incorecte, accidentelor, nerespectării instrucțiunilor de utilizare sau încercărilor de adezasambla sau repară desinestătător aparatul. Garanția este valabilă doar dacă este prezentat certificatul de garanție care este completat corect și conține stampila societății comerciale.

Tensiometru automat non-invaziv Dr.Frei M-200A

Producător: Shenzhen Pango Electronic Co., Ltd; No.25 1st Industry Zone, Fenghuang Rd, Xikeng Village, Henggang Town, Longgang District Shenzhen City, Guangdong Province, China.

Reprezentant Autorizat/Importator în Republica Moldova:

ÎM "Delta-Medica" SRL, MD-2068, Republica Moldova, mun. Chisinău, str. A. Russo 15, of. 37. Tel. +373 22 313 892, Fax: +373 22 313 725; Linia fierbinte de pe număr fix: 0 800 10 0 10. A se păstra la temperatură de la -20°C până la +55°C.

Termen de valabilitate nelimitat.

S/N: vezi pe partea verso a dispozitivului. Centrul de Deservire: or. Chisinău, str. Hristo Botev, 29. Tel.: +373 62 061 998.

Nr. de înregistrare: DM000010651 din 22.08.2016

Data ultimii revizuiri a textului manualului de utilizare: 23.02.2021

ҚҰРМЕТТИ DR. FREI СМ ЖАРТЫЛАЙ АВТОМАТТЫ ӨЛШЕУІШІНІҢ ҚОЛДАНУШЫСЫ

Сізге біздің Dr. Frei® M-200A автоматты артериалды қысым өлшеуіш мәделін таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біз сенімдіміз, аталған құралға шынайы баға бере отырып сізді Dr. Frei® Швейцария сауда маркасының тұрақты қолданушысы болатыныңызға. Осы құралды қолдануды бастамас бұрын нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Онда Сіз артериалды қысымды және қантамыр соғысын өлшеуді дұрыс жүргізуге қажетті барлық ақпаратты табасыз. Егер де, сіз де, қандай да бір сұрақтар туындастын болса, онда сіз өзіңіздің мемлекетініздегі Dr. Frei® сауда маркасы орталығына жолығыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Осы артериалды қысым өлшеуіш өздігінен артериалды қысымды бақылауға арналған, өздігінен гипертония/гипотония диагностикасына емес. Ешбір жағдайда артериалды қысым өлшеуіш арқылы алынған нәтижелері негізінде өздігінен диагноз қоймаңыз. Өзін-өзі емдеумен айналыспаңыз және алдын ала дәрігермен ақылдаспай, Сізге жазылған емделудің тәсілдерін өзгертпеніз.



BF қорғау сыныпы.



Құралды қолданудан алдын қолдану жөніндегі нұсқаулықпен танысыңыз.

МАЗМҰНЫ


АРТЕРИАЛДЫ ҚЫСЫМ ЖӘНІНДЕ НЕ БІЛУ КЕРЕК?	91
Артериалды қысым деген не	91
Артериалды қысым нормалары.....	92
М-200А АВТОМАТТЫ АРТЕРИАЛДЫ ҚЫСЫМДЫ	
ӨЛШЕУІШ МОДЕЛІНІҢ АРТЫҚШЫЛЫҒЫ.....	93
АҚ деңгейінің индикаторы	93
Жүрек соғысының жайліктерінің ақауларын шығару технологиясы (ИНВ).....	93
ӨЛШЕУГЕ ДАЙЫНДЫҚ.....	94
Маңызды ақпарат.....	94
Жинақталуы.....	95
Құралдың сыртқы түрі және сипаттамасы	95
Батарейкелерды орнату	95
Уақыт/күннің орнату.....	96
Қолданушы таңдау.....	97
Жүйелік адаптерді қосу	97
Манжетаны қосу	98
ӨЛШЕУДІ ЖҮРГІЗУ	98
Манжеталарды орнату.....	98
Өлшеу процесі	99
Өлшеу нәтижелерін оқу	99
Өлшеуді тоқтату	100
«ЖАД» ФУНКЦИЯСЫ.....	100
Сақталған шамаларды қарастыру	101
Барлық мәндерді жою	101
АҚАУЛАРДЫ РЕТТЕУ	102
САҚТАУ ЖӘНЕ КҮТИМ	104
ТҮРТІНДІНІҢ СИПАТТАМАСЫ.....	105
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ.....	105
КЕПІЛДІК	106

АРТЕРИАЛДЫ ҚЫСЫМ ЖӨНІНДЕ НЕ БІЛУ КЕРЕК?


Артериалды қысым деген не

Артериалды қысым – артерия қабыргаларындағы қан қысымы. Артериалды қысым (АҚ) ағзадағы қанның үздіксіз айналуын қамтамасыз ету үшін қажет. Оның арқасында ағза жасушалары өздерінің қалыпты қызмет атқаруын қамсыздандыратын оттегіні алады қан итеруші «сорғы» жүрек болып табылады. Жүректің әрбір соғысы АҚ белгіленген деңгейін қамтамасыз етеді.

АҚ 2 түрі бар: систоликалық (жоғарғы) қысым, ол артерияларға қанды итеру кезіндегі жүрек жиырылуына сәйкес; және диастоликалық (төменгі) қысым, ол жүректің екі жиырылуы арасындағы қысымға сәйкес.

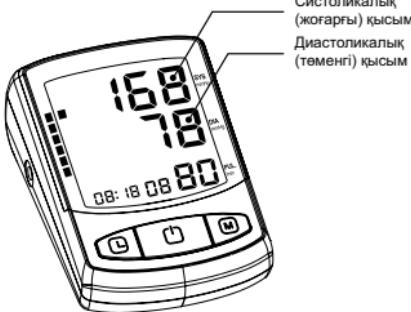

Адамның артериалды қысымының тәуліктік ритмі

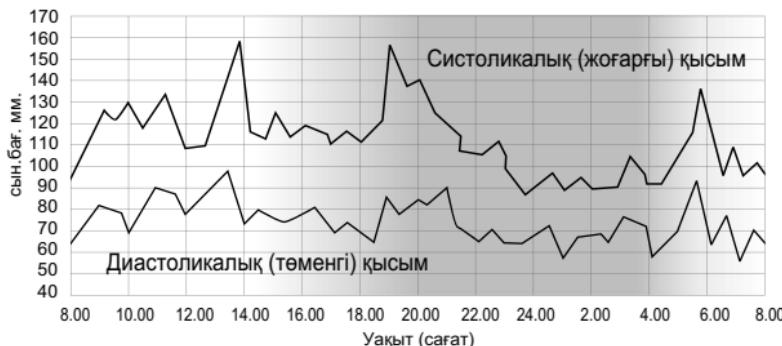

Артериалды қысымның жоғарлауы жүрекке тиетін жүктемені арттырады, қантамыр жолдарына әсер етеді, олардың қабыргаларын жуан және икемсіз қылады. Гипертонияның бір сипаттамасы оның бастапқы кезеңде науқас адамның өзіне білінбей өті мүмкін екендігі болып табылады.

Міне сондықтан АҚ өздігінен бақылау осындай жоғары маңызға ие. Аурудың дамуы барысында бас ауруы, үздіксіз бас айналулар пайда болады, көрү қабілеті, өмірлік маңызға ие органдардың – ми, жүрек, бауыр, қантамыр жолдарының жұмыс істеуі нашарлайды, Сәйкес емдегу болмаса, жоғары артериалды қысымның бауырдың бұзылуы, стенокардия, паралич, сөйлеу қабілетінен айырылу, ақылдан айырылу, миокард инфарктісі және бас миының инсульті сияқты зардаптарына әкелуі мүмкін.

Артериалды қысым нормалары

Артериалды қысым нормаларына қатысты әлемдік стандарт ретінде Дүниежүзілік Денсаулық сақтау Ұйымының (ДДҰ) Классификациясы* танылады:

АҚ категориясы	Систоликалық АҚ (сын.баг. мм.)	Диастоликалық АҚ (сын.баг. мм.)
Артериалдық қысым өте төмен	< 100	< 60
Оптимальды артериалды қысым	100 - 119	60 - 79
Қалыпты артериалды қысым	120 - 129	80 - 84
Артериалдық қысым аздал жоғары	130 - 139	85 - 89
Артериалдық қысым өте жоғары	140 - 159	90 - 99
Артериалдық қысым аса жоғары	160 - 179	100 - 109
Артериалдық қысым қауіпті жоғары	≥ 180	≥ 110

* қысқартылумен келтірілген.

- ГИПЕРТОНИЯ диагнозы кезінде дәрігермен белгіленген дәрілік емдеуді, және өмір сүру тәсілін реттеуді біріктіру қажет.
- Жоғары қалыпты және қалыпты АҚ кезінде дәрілік заттарды қолданбай АҚ деңгейін оптимальдыға дейін тусыру бойынша шараларды қолдану арқылы өздігінен бақылауды жүргізу ұсынылады.
- 50 жылдан астам жаста жоғары(сын.баг. 140 мм.астам) систоликалық қысым диастоликалық қысымға қарағанда жоғары маңызға ие.
- Қалыпты АҚ кезінде де гипертонияның даму қауіпі қартайған сайын артады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Егер тыныш қалыпта АҚ көрсеткіштері шамалардан аспаса, алайда физикалық немесе рухани қажыған кезде аса жоғарланған нәтижелер байқасаңыз, бұл лабильды (яғни тұрақты емес) гипертонияны көрсетуі мүмкін. Егер сізде осы құбылысқа күмән болатын, дәрігерге қаралуды ұсынамыз.

Егер қан қысымын дұрыс өлшеу кезінде диастоликалық қысым сын,- бағ, 120 мм астам болса, кідірмesten дәрігерді шақыру керек.

M-200A АВТОМАТТЫ АРТЕРИАЛДЫ ҚЫСЫМДЫ ӨЛШЕУІШ МОДЕЛІНІҢ АРТЫҚШЫЛЫҒЫ

АҚ деңгейінің индикаторы

Артериалды қысым деңгейінің индикаторы дисплейдің сол жақ шетінде орналасқан. Сыныпталуы диапазонға сәйкес, «Артериалды қысым нормалары» атты кестесінде көрсетілген. Ақөлшегеннен кейін пунктір дисплейдің сол жақ шетінде жыпылықтайты: жасыл аймақ - оптимальды қысым, сары - жоғары, сарғылт - ете жоғары, қызыл - қауіпті жоғары. Атальған функция сізге өздігінен алынған АҚ нәтижелерін түсінуінзге мүмкіндік береді.

Жүрек соғысының жиіліктерінің ақауларын шығару технологиясы (IHB)

Атальған технологиясы жүректі тұрақты соқпауын анықтауға мүмкіндік береді. Егер құрал дисплейінде IHB технологиясының белгісі пайда болса, артериалды қысымды өлшеу кезінде құрал жүрек жиырылуы жиілігінің қандай да бір ақауларын тапқанын билдіреді. Қандай да бір нақты жағдайда мұндай нәтиже Сіздің қалыпты артериалды қысымыңыздың өзгеруіне байланысты болуы мүмкін, өлшеуді тағы бір рет қайталаңыз. Көптеген жағдайларда уайымдайтын себеп жоқ. Алайда IHB белгісі тұрақты пайда бола берсе (мысалы, күн сайынғы өлшеулер кезінде аптасына бірнеше рет), біз, Сізге осы жайлы дәрігерге хабарлауыңызды ұсынамыз. Өзініздің дәрігерінізге келесі түсініктемені көрсетіңіз:

Жүрек соғысының жиіліктерінің ақауларын шығару технология-

СЫ БАЙЛАНЫСТЫ МЕДИКТЕРГЕ АРНАЛҒАН АҚПАРАТ (ИНВ)

Аталған құрал өлшеумен қатар қантамыр соғысының жиілігін сараптау функциясы бар артериалды қысымының осциллометрикалық өлшеуіші болып табылады. Құрал клиникалық мақұлданған.

Артериалды қысымды өлшеу кезінде құрал қантамыр соғысының жиілігінің қандай да бір ақауларын тапса, өлшеуі аяқталғаннан кейін құралда  ИИВ технологиясының белгісі пайда болады. Егер белгі жиі пайда бола берсе (мысалы, күн сайынғы өлшеулер кезінде аптасына бірнеше рет), біз медициналық қаралуға жүргінуді ұсынамыз.

Бұл құрал ешбір жағдайда кардиологиялық тексеруді алмасытра алмайды, алайда ол ерте кезіндегі жүрек жиырылуы жиілігінің қандай да бір ақауларын табуға мүмкіндік береді.

ӨЛШЕУГЕ ДАЙЫНДЫҚ

Маңызды ақпарат

1. Құралды ТЕК ҚАНА мақсаты бойынша қолданыңыз, нұсқаулығының ішінде жазылғандай.
2. Өндірушімен көрсетілмеген аксессуарларды, ҚОЛДАНБАҢЫЗ.
3. Құралды қолданбаңыз, егерде ол дұрыс жұмыс істемесе, немесе зақымдалған болса.
4. Құралды қолданбаңыз, шашыраған аэрозоль жерлерінде, жәнеде, оттегінің жеткізілетін жерлерінде.
5. Еш уақытта құралды ҚОЛДАНБАҢЫЗ, сәбілер немесе кішкентай балалар үшін.
6. Аталған құрал ауру түрлерін немесе қандай да бір белгілерді емдеу үшін ЖҮРГІЗІЛМЕЙДІ. Өлшеу нәтижесі тек қана ақпарат үшін арналады. Кеңес үшін дәрігерге жүргініз.
7. Құралды және майысқақ бауын ыстық жоғары жерлерінде сақтауға БОЛМАЙДЫ.
8. Манжетаны білегінізден басқа дene мүшелеріне КИМЕҢІЗ.
9. МАҢЫЗДЫ дұрыс қолдану, құралдың қызмет ету мерзімін ұзарту мақсатында, кезеңді тексерісті жүргізіп тұру. Егерде сіз құралдың нақты көрсетімдеріне сенімсіз болсаңыз, жергілікті сервис орталығына жүргініз.
10. Аталған құрал жасы 18 асқан тұлғалар үшін қолданылады.
11. Құралды гипертония диагнозын қою үшін қолданбаңыз, сондай ақ нәрестелердің қысымын өлшеу үшін, кішкентай балаларға немесе тұлғаларға қолданбаңы, ез келісімін бермеген.

12. Аталған құралмен алынған, өлшеу нәтижелерін, ТЕК ҚАНА дәрігер бағалау керек, егер сізге келесідей диагноз қойылса аритмияның қатты түрі немесе үздікті жүрек соғысы, жүрек алды, немесе қарынша экстрасистолиясы, жыптылықтау аритмиясы сияқты.

АТАЛҒАН НҰСҚАУДЫ ҚҰРАЛДЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІНІҢ АЯҒЫНА ДЕЙІН САҚТАҢЫЗ

Жинақталуы

Жинаққа M-200A автоматты артериалды қысым өлшеуіш моделі, манжетттер (22 - 42 см), 4 батарейка AA, желілік адаптер, қолдануыш нұсқаулығы, кепілдік талоны, қаптама.

Құралдың сыртқы түрі және сипаттамасы

Суретте M-200A моделінің автоматты артериалды қысым өлшеуіші көрсетілген.



Жинақта:



Нұсқаулық



Манжетта




Адаптер

* Dr. Frei маркасының адаптерін ғана қолданыңыз.

Батарейкаларды орнату

1. Батарейкаларға арналған белім қақпағын шешіңіз (суретті қараңыз).
2. Батарейкаларды орнатыңыз, полярлығын сақтай отырып.
3. Қорғаушы қақпағын жабыңыз. LR6, AA типіндегі батарейкаларды қолданыңыз.

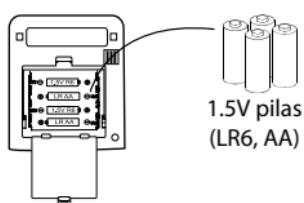

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ


- Дисплейде  батарейканың ескерту белгісінің пайда болуы батарейканың өз ресурсын бітіргенін, және оларды жаңаларымен ауыстыру керек екенін білдіреді. Дисплейде  батарейканың ескерту белгісінің пайда болғаннан кейін құрал жаңа қоректену элементтері орнатылғанша блокқа қойылады.
- Егер құрал ұзақ уақыт бойы қолданылмаса, одан батарейкаларды алып қоюға ұсынылады.
- АА (сілтілі, 1,5 В) типті батарейкаларды қолдану ұсынылады. 1,2 В зарядталатын аккумуляторларды қолдануға ұсынылмайды.
- Дисплейдің барлық элементтерін тексеру үшін Қосу/Сөндіру түймесін басқан күйінде ұстап тұрыңыз. Құралдың қалыпты жұмыс істеуі кезінде барлық элементтер белгілері жанады.

ЕСКЕРТУ: Батарейкаларды үнемдеу мақсатында құрал автоматты түрде 1 минут әрекетсіздіктен немесе Қосу/Сөндіру түймесін басқаннан кейін сөндіріледі.

Уақыт/кунін орнату

«Уақыт/куні» функциясының арқасында, әр өлшеуді жүргізу кезінде өлшеу нәтижелерін жадыда дәл жүргізілген уақытымен бірге сақтауға болады.

- Құралды іске қосу үшін, «» түймесін басыңыз.
- Экран бетінде «Жыл» жыпылықтағанша, «» түймесін басыңыз.
- Кейіннен, «M» түймесін басып, керекті мәнін таңдаңыз. «» түймесін басып өз таңдауынызды растаңыз.
- Дәл солай, айын, кунін, уақытын, минутының мәндерін енгізіңіз.



жылы



айы



куні



сағаты



минуты

ЕСКЕРТУ:

- Егер сізге күнін және уақытын езгерту қажет болса, басып және ұстап тұрыңыз басқан түйменізді 3 секунд ішінде Уақыт/Күнін сол уақытқа дейін, жыл сандары жыпылықтап бастағанша. Кейінен

жана мәндерді енгізуге болады, жоғары көрсетілген нұсқаулыққа сәйкес.

- Әр Жады және Уақыт/Күні батырмасын басу кезінде бір операция жүзеге асырылады (мысалы, келесі орнатылу режиміне аудысу немесе мәндердің өзгеруі +1)
- Түймені басып тұру арқылы талап етілетін режимге аудысдың жеделдетілуіне немесе қажетті санды іздемек болғанда.

Қолданушы таңдау

Аталған артериалдық қысым өлшеуіші жадысында 30 нәтижені сақтай алады екі қолданушының әр қайсысы үшін. Қолдануды бастамас алдын, сіз құралды қажетті қолданушыға аудыстырганыңызға көз жеткізуіңіз.

1. Құрал қосылғанда, «SET» түймесін басып ұстап тұрыңыз экранның сол жақ жоғары шетінде қолданушы символы жыптылықтағанша.
2. Жады «SET» түймесін басыңыз, қолданушыны аудыстыру үшін.
3. Қосу/Сөндіру түймесін басыңыз, таңдалып алған қолданушыны растау үшін.



Жүйелік адаптерді қосу

M-200A автоматты артериалды қысым өлшеуіш моделінің құралысында жүйелік адаптерді қосу мүмкіндігі қарастырылған.


1. Адаптер штекерін құралдың тәменгі бөлігінде орналасқан үшышыққа қосыңыз. Осы уақытта құралдың батарейкалардан қоректенуі автоматты тоқтатылады.
 2. Адаптерді 220/110 В тоқ көзіне қосыңыз. Құрал жұмысқа дайын.
 3. Құралдың қосылуын Қосу/Сөндіру түймесін басу арқылы тексеріңіз.
- ЕСКЕРТУ:**
- Dr. Frei маркасының адаптерін ғана қолданыңыз. Кез келген басқа адаптерді қолданған кезде қызмет көрсету орталығы құралды кепілдік қамсыздандыру міндеттемелерінен босатылады.



- Айнымалы тоқ адаптері құралға қосылған кезде батарейкалар шығындалмайды.
- Егер Сізде құрылғының айнымалы тоқтан жұмыс істеуіне қатысты сұрақтар туындаса, сату үйіміна немесе қызмет көрсету орталығына жолығуыңызды сұраймыз.

Манжетаны қосу

Құрал пішінінде орналасқан жалғағыш ішіне манжета қосыбышын қосыңыз, суретте көрсетілгендей етіп.

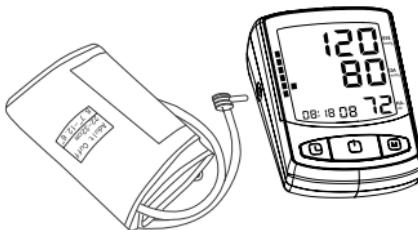

ӨЛШЕУДІ ЖҮРГІЗУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

- Өлшеуден бұрын тыныш, маужыраған қалыпта біршама уақыт отырған тиімді.
- Емделушінің әрбір күштенуі, мысалы, қол тіреу, қан қысымын жоғарлатуы мүмкін. Дене маужыраған күйінде болуына назар аударыңыз, және Сіз өлшеу жүргізіп жатқан қолдағы ешбір бұлшық етке күш тусірменіз.
- Қысымды әрқашан бір ғана қолда жүргізіңіз (негізінен сол қолда).
- Сол қолды киімнен босатыңыз. Жеңді қайырмаңыз, себебі ол Сіздің қолыңызды қысады, және бұл өзшеу кезіндегі дәлдікке әсер етеді.
- Клиникалық тексерілген түпнұсқалық манжетті ғана қолданыңыз!
- Егер Сіз өзіңіздің артериалды қысым есебін жүргізгіңіз келсе, өлшеуді бір уақытта жүргізуге тырысыңыз, себебі артериалды қысым тәулік уақытына байланысты өзгеріп отырады.
- Өлшеу дұрыс жүргізілуі үшін қайта өлшеуді 5-минуттық үзілістен кейін ғана жүргізу керек.

Манжеталарды орнату

1. Манжетаны құралға қосыңыз, манжета қосыбышын құралдың сол жағында орналасқан манжета ішіне.

2. Сол (оң жақ) қолыңызды өзініздің алдыңызға алақаныңызбен жоғары қарай созып жайғасыңыз. Манжетаны қолыңызға орнатыңыз шынтақтан жоғары қарай. Артерия белгісі манжета шетінен 2-3 см қашықта орналасу керек, шынтақ бүккішінен жоғары, әуе тұтігі - қолдың ішкі жағынан.
3. Манжетамен қолыңыздың арасындағы арақашықтық екі саусақ сиятында болу керек. Күімінізді шешініз, қолыңызды жабатын немесе қысатын, өлшеу жүргізілетін қолға қатысты.
4. Манжетаны жабысқаққа дұрыс орнатыңыз. Көз жеткізіңіз, жоғарғы және төменгі шеттері манжетаның тегіс орналасқандығыңызға.




Өлшеу процесі

Әр дайым құралды, манжетаны кигеннен кейін қосыңыз.

1. «ON/OFF» түймесін басыңыз. Барлық символдар 2 секунд ішінде экран бетінде айқындалады, кейін өлшеу режимі қосылады, экран бетінде «0» пайда болады немесе соңғы өлшеу нәтижесі.



2. Манжета автоматты түрде үрленеді. «♥» индикаторы экран бетінде жыпылықтап бастайды. Өлшеуден кейін экран бетінде өлшеу нәтижесі пайда болады.

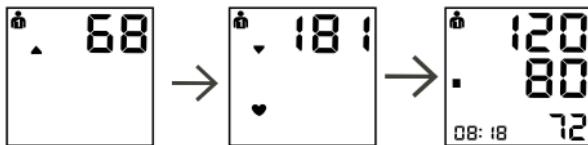

Өлшеу нәтижелерін оқу

Өлшеу жүргізілгеннен кейін дисплей бетінде қан тамыр соғысының

және артериалдық қысымының өлшеуі көрінеді, артериалдық қысым деңгейін көрсететін Халықаралық деңсаулұлық сақтау үйымы межелігі (шакала) бойынша.

Символы  пайда болса құралдың ретсіз жүрек соғысы ақауларын аяқтаганын білдіреді. Бұл индикатор ескерту қызметін атқарады.

ЕСКЕРТПЕ: Біз сізге дәрігерге жүгінінізді сұраймыз, егерде мұндай символ үнемі пайда болатын болса (3 - 5 рет аптасына құнделікті өлшеулерде пайда болатын болса). Ұмытпаңыз, өлшеу жүргізу уақытында отырып, бойынызды еркін ұстаңыз, және сөйлеменіз.

Артериалдық қысым қауіп тәндіретін

- Артериалдық қысым аса жоғары
- Артериалдық қысым өте төмен
- Артериалдық қысым аздап көтеріңкі
- Артериалдық қысым қалыпты
- Артериалдық қысым оптимальды



Өлшеуді тоқтату

Егер қандай да бір себеп бойынша өлшеуді тоқтату керек болса (мысалы, көнілкүй нашар болса), Қосу/Сөндіру түймесін басыңыз. Құрал сөнеді және манжетадан ауа шығарылады.



«ЖАДЫ» ФУНКЦИЯСЫ

Өлшеуді аяқтаганнан кейін аталған құрал автоматты түрде нәтижені күні және уақытымен бірге сақтайды. Құралдың жадысы 30 өлшеу жүргізуге есептелген әр қолданушы үшін жеке дара.

Сақталған шамаларды қарau

Құрал сөніп тұрғанда, Жады түймесін басыңыз. Дисплей бетінде **Avg** айқындалады, кейіннен 10 минут ішінде үш өлшеудің орташа мәні. Назар аударыңыз: егерде жады ішінде 10 минут ішінде мәндер сақталмаса, онда дисплей бетінде «0» белгісі айқындалады. Егер жады ішінде соңғы мән сақталған болса, дисплей бетінде соңғы сақталған мән айқындалады; егер жадыда екі өлшеу сақталған болса, дисплейде атапан өрнек айқындалады. Соның ішінде өлшеу нәтижелері және орташа мәні жадыда әр қолдану үшін жеке дара сақталады. Сақталған шамаларды қарай отырып, көз жеткізіңіз, өзіңізге керекті қолданушыға ауыстырығаныңызға.


Жады түймесін қайтадан басып, дисплей бетінде осығын дейінгі нәтиже суреттеледі. Белгілі нәтиженің қараша үшін басыңыз және жады түймесін басып үстап тұрыңыз қажетті нәтижеге өту үшін. Егерде құрал ырғақсыздықты анықтаса, дисплей бетінде суреттеледі, өлшеу нәтижесінен басқа, күні және уақытыда.

ЕСКЕРТУ: Ұсынылмайды бірінің артынан бірін өлшеу жүргізуге, алайда ол теріс нәтиженің алудына алып келеді. Бірнеше минут тынығыңыз, отырып немесе жатып, келесі өлшеу жүргізуден алдын.

Барлық мәндерді жою

Құрал жадысынан барлық сақталған мәндерді жоюдан алдын, көз жеткізіңіз, олардың келешекте сізге керек емес екендігіне. Қажеттілігі-не орай өлшеу нәтижелерін жазып отырыңыз, дәрігерге ұсынатындей жағдайда.

Барлық сақталған нәтижелерді жою үшін, Жады түймесін басып үстап тұрыңыз, дисплей бетінде «» символы жыптылықтағанша. Түймені жіберіңіз. Кейіннен жады түймесін қайтадан басыңыз, «» символы жыптылықтағанша операцияны тәмамдау үшін. Жеке өлшеулерді жою мүмкін емес.

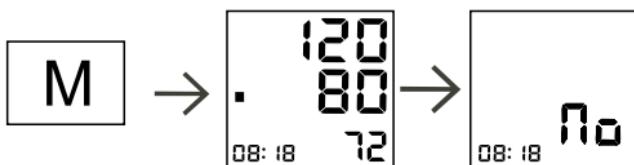

АҚАУЛАРДЫ РЕТТЕУ

Егерде сіз көрсетілген әрекеттерді орындасаңыз, алайда ақаулар қайтадан көрінетін болса, немесе төменгі кестеде көрсетілмеген ақаулар шығатын болса, онда сервис орталығына жүгініңіз. Еш уақытта құралды өздігінен жөндеуге тырыспаңыз.

Экрандағы хабарлама	Түннің мүмкін себеп	Қалпына келтіру
Сіз ON/OFF түймесін басқан кезінде экран бетінде ештеңе көрінбейді немесе жыптықтайтын  символ пайда болады батарейкалардың тауысылғандығын баяндайтын.	Батарейкалар орнатылмаған	Батарекаларды салыңыз
	Батарейкалар тауысылған	Батарейкаларды жаңасына ауыстырыңыз
	Батарейкалардың полярлығы бұзылған	Полярлығын сақтап, батарейкаларды салыңыз
E1 Қалыпты манжетаны үрлеу жүргізілмей жатыр	Манжетаны герметилігіне сай тексеріңіз	Манжетаны жаңасына ауыстырыңыз
E3 Құрал манжета ішіне ауаны аса жоғары айдамалап жатыр		Қайтадан өлшеуді жүргізіңіз немесе құралды сервис орталығына тексеру үшін жіберіңіз
E2 E4 Өлшеу жүргізу кезінде қолыңыз қимылдаған	Қолыңыз немесе дененің өлшеу жүргізу кезінде қимылдаған	Өлшеу жүргізу кезінде қимылдамаңыз және қайталап өлшеуді жүргізіңіз
 Батарейка символы	Батарейкалардың төменгі қуаты	Батарейкаларды ауыстырып және өлшеуді қайтадан қайталаныз

Систоликалық немесе диастоликалық қысымы өте жоғары.	Білектегі манжета деңгейінен тәмен орналасқан	Дұрыс қалыпты таңдал және өлшеуді қайтадан жүргізіңіз
	Манжета дұрыс киілмеген	
	Өлшеу жүргізу кезінде сіз сөйлемдіңіз немесе қимылдаудыңыз	
Систоликалық немесе диастоликалық қысымы өте тәмен	Білектегі манжета деңгейінен жоғары	

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Егер артериалды қысым өлшеуішінде техникалық ақаулар пайда болса, сіздің мемлекеттіңдері Dr. Frei CM ресми өкілінің сервис орталығына жүгініңіз. **Ешбір жағдайда құралды өздігінен жөндеуге тырыспаңыз!** Құралды өздігінен ашқан жағдайда кепілдік өз күшін жояды.

ЕСКЕРТУЛЕР: Артериалды қысымның уақыт өте өзгеру қасиеті сау адамдарда да байқалады. Өлшеу нәтижелерін салыстыру мүмкіндігіне ие болу үшін, бұл өлшеулер жуықтап бір уақытта және бірдей жағдайларда (тыныш қалыпта) жүргізілу керек екендігіне назар аударыңыз! Егер Сіз жоғарыда көрсетілген барлық талаптарды орындағаныңызға қарамастан, қысым өзгеруі сын. бағ. 15 мм. астам болса және/немесе Сіз бірнеше рет тұрақты емес қантамыр соғысын естісөніз, дәрігерге қаралыңыз.

САҚТАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

Артериалды қысым өлшеуішті құрғақ, аса жоғары/төмен температуралар, шаң және тікелей күн сәулелері өсерінен қорғалған жерде сақтаңыз.



Ішіндегі сезімталды бөлігін бұлдіріп алмай үшін манжетаны айналдырмаңыз және бүкпеніз.



Өлшеуішті тазалау үшін таза жұмсақ майлышты қолданыңыз. Бензин, еріткіш және басқа да осы тектес құралдарды қолданбаңыз. Манжетадағы дақтарды сабын ерітін-дісімен ылғалдандырылған мата көмегімен абайлап кетіріңіз. Манжетаны жумаңыз!



Байланыстыруши ауа шлангісімен абайлап қолданыңыз. Манжетаны және резенке түтікшелерді үшкір заттардан сақтаңыз.



Өлшеуішті құлатып алмаңыз және қолдану кезінде күш қолданбаңыз.



Ешқашан құралды ашпаңыз! Әйтпесе құралдың зауыттық калибрлеуі бұзылады.



ТҮРТІНДІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

ТҮРТІНДІ	СИПАТТАМА
	Қолдануышы нұсқауын қараңыз
	Өндіруші
	Сериялық нөмірі
	Назар аударыңыз, жолдама құжаттарын қараңыз
	Сіздің мемлекетіңіздегі талаптарға сәйкес жойыңыз
	ВF типті жабдық
	Қорғау сыныпты II
	СЕ маркировкасы

Құралдың периодты калибрлеуі

Өлшеуіш аспаптардың дәлдігін уақыт өте тексерілуі керек. Осы себептен периодты түрде, сатып алушының сатып алған немесе қолдануды бастаған кезден бастап екі жылда бір рет статистикалық қысым индикациясын тексеру жүргізуге ұсынылады. Толығырақ ақпаратты Сіз қызмет көрсету орталығында ала аласыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Өлшеу әдісі	Оциллометриялық
Индикация	Сандық СК-дисплей
Өлшеу диапазоны:	Қысым: 30 - 280 мм сын. бағ. Қан тамыр соғысы: 40 - 199 сок/мин.
Өлшеу нақтылышы:	Қысым: ± 3 мм сын. бағ. Қан тамыр соғысы: ± 5%

Жады:	30 нәтиже әр қолданушы үшін
Қоректену қайнары:	Батарейкалар 4 x 1,5 В (LR 6 немесе AA)
Жұмыс температураларының диапазоны:	+5 - +40 °C, салыстырмалы ылғалдығы: 15% - 93%, атмосфералық қысым: 70 кПа - 106 кПа
Сақтау шарттары:	-20 - +55 °C, салыстырмалы ылғалдығы: 0% - 93%, атмосфера-лық қысым: 50 кПа - 106 кПа
Құрал өлшемі:	135 (ұзындығы) x 90 (еңі) x 62 (бійктігі) мм
Салмағы:	380 г батарейкаларсыз
Манжета өлшемі	22 - 42 см
Классификация	Тип BF
Желілік адаптер	Кіру: 100 - 240 В, ~50/60 Гц, 0.2 А Шығу: 6 В — 500 мА

* Техникалық сипаттамалары өзгеріліуі мүмкін алдын ала хабарлаунысыз.

КЕПІЛДІК

М-200А автоматты артериалды қысым өлшеуіш моделіне сатып алу күнінен бастап 5 жыл кепілдік беріледі. Манжетаға кепілдік, сатып алған күннен бастап 1 жылға беріледі. Кепілдік дұрыс емес қолдану, төтенше жағдайлар, қолдану бойынша нұсқаулықты сақтамау немесе өздігінен құралды ашу және/немесе жөндеу нәтижесінде пайда болған ақауларға таралмайды. Кепілдік қызмет көрсету орталығына сауда үйимының мөрі бар дұрыс толтырылған кепілдік талонын көрсеткен жағдайда ғана жарамды болады.

Қазақстандағы импортшы/ Импортер в Казахстане «MedHouse Swiss Kazakhstan»/«МедХауз Свисс Казахстан» ЖШС-гі, Претензии по качеству товара/Таярап сапасы жөніндегі наразылықтарды қабылдайтын «MedHouse Kazakhstan»/«МедХауз Казахстан»/ ЖШС-гі, расположена по адресу/орнадасқан мекен жайы: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Б. Майлин көшесі 4/1, 25 кеңсе, тел.8 717 2 97 82 69, 8 8000 702 486. Зарегистрирован на территории РК/КР аумағында тіркеլген РК-МТ-5№016144

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА АВТОМАТИЧНИЯ АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ С ТЪРГОВСКА МАРКА DR. FREI

Благодарим Ви, че избрахте автоматичния апарат за измерване на кръвно налягане с търговска марка **Dr. Frei®** модел M-200A. Ние сме сигурни, че оценявайки по достойнство качеството на този уред, Вие ще станете постоянен потребител на продуктите на швейцарската търговска марка **Dr. Frei®**.

Прочетете внимателно инструкцията преди употребата на този уред. В нея ще намерите цялата необходима информация за правилното провеждане на измерването на артериалното налягане и пулса. По всички въпроси, касаещи дадения продукт, молим да се обръщате към официалния представител или в сервиза на **Dr. Frei®** във Вашата страна.

ВНИМАНИЕ

Този апарат за измерване на артериалното налягане е предназначен за осъществяване на наблюдение на артериалното налягане, а не за самодиагностика на хипертония/хипотония. В никакъв случай не поставяйте диагноза самостоятелно на основата на резултатите, получени с помощта на аппарата за кръвно налягане. Не се самолекувайте и не сменяйте самостоятелно предписаните методи на лечение без предварителна консултация с лекар.



Клас на защита BF.



Преди употреба на уреда внимателно прочетете приложената инструкция.

СЪДЪРЖАНИЕ

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА АРТЕРИАЛНОТО НАЛЯГАНЕ.	109
Какво е артериално налягане	109
Норми на артериалното налягане	110
ПРЕДИМСТВА НА АВТОМАТИЧНИЯ АПАРАТ ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ МОДЕЛ М-200А	111
Индикатор за нивото на АН.....	111
Технология за откриване на нарушения в честотата на сърдечния ритъм (ИНВ).....	111
ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА	112
Важна информация	112
Комплектоване	113
Външен вид и описание на уреда	113
Поставяне на батерии	113
Въвеждане на дата/час	114
Избор на потребител	115
Включване на мрежов адаптер.....	115
Включване на маншета	116
ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗМЕРВАНЕ	116
Поставяне на маншета	116
Процес на измерване	117
Разчитане на резултатите от измерването	117
Прекъснати измервания	118
ФУНКЦИЯ «ПАМЕТ»	118
Преглед на запазените стойности	119
Изтриване на всички стойности	119
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	120
СЪХРАНЕНИЕ И ГРИЖА	122
ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИТЕ	123
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	123
ГАРАНЦИЯ	124

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА АРТЕРИАЛНОТО НАЛЯГАНЕ


Какво е артериално налягане

Артериално налягане е налягането на кръвта върху стените на артериите. Артериалното налягане (АН) осигурява постоянна циркулация на кръвта в организма. Благодарение на него клетките получават кислород, който осигурява нормалното им функциониране. «Помпата», изтласкваша кръвта в съдовете, е сърцето. Всеки удар на сърцето осигурява определено равнище на АН.

Съществуват два вида АН: систолично (горно) налягане, което съответства на съкращаване на сърцето, при което става изтласкване на кръвта в артериите; и диастолично (долно) налягане, което съответства на налягане на кръвта между две свивания на сърцето.



Денонощен ритъм на артериалното налягане при човека

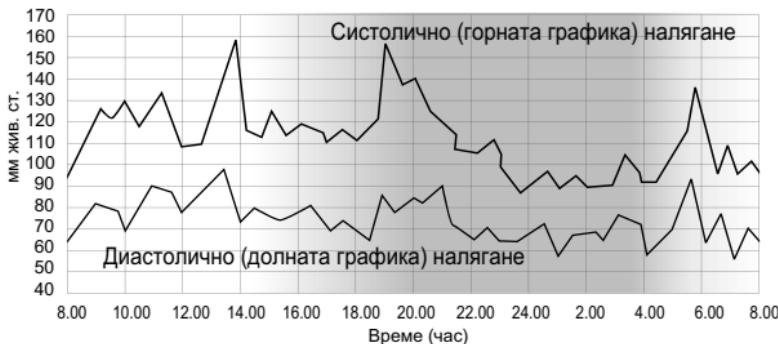

Повишаването на артериалното налягане увеличава натоварването на сърцето, влияе на кръвоносните съдове, правейки стените им

по-дебели и по-малко еластични.

Една от характеристиките на хипертонията е това, че в началния етап тя може да протича незабележимо дори за самия болен. Именно затова наблюденето на кръвното налягане играе такава важна роля. С прогресиране на заболяването възникват главоболие, постоянно виене на свят, влошава се зрението, функционирането на жизнено-важните органи - главен мозък, сърце, бъбреци, кръвоносни съдове, също се влошава.

При липса на съответната терапия са възможни такива последици, като поражение на бъбреците, стенокардия, парези и парализи, загуба на говора, слабоумие, инфаркти и инсулти.

Норми на артериалното налягане

Международен стандарт за нормите на артериалното налягане според Световната здравна организация (СЗО):

Категория	Систолично (мм жив. ст.)	Диастолично (мм жив. ст.)
Артериалното налягане е много ниско (Хипотония)	< 100	< 60
Оптимално артериално налягане	100 - 119	60 - 79
Нормално артериално налягане	120 - 129	80 - 84
Повишено артериално налягане	130 - 139	85 - 89
Високо артериално налягане (Хипертония I-ва степен)	140 - 159	90 - 99
Високо артериално налягане (Хипертония II-ва степен)	160 - 179	100 - 109
Застрашаващо високо артериално налягане	≥ 180	≥ 110

- При диагноза ХИПЕРТОНИЯ е нужно съчетаване на медикаментозно лечение, препоръчано от лекар, и промяна на начина на живот.
- При високо или нормално АН се препоръчва наблюдение с цел навременно вземане на мерки за сваляне на АН до оптималното без вземане на лекарства.
- При възраст над 50 години високото (над 140 мм жив. ст.), систолично налягане играе по-важна роля, отколкото диастоличното.
- Даже при нормално АН рисъкът от развитие на хипертония се увеличава с възрастта.

ВНИМАНИЕ

Ако измерените в състояние на покой показатели на АН не са необичайни, но в състояние на физическа или душевна преумора Вие наблюдавате повишаване на резултатите, възможно е това да показва наличието на така наречената лабилна (т. е. неустойчива) хипертония. Ако подозирате това явление, препоръчваме да се обърнете към лекар. Ако при правилно измерено артериално налягане диастоличното артериално налягане е по-високо от 120 мм жив. ст., е необходимо незабавно да повикате лекар.

ПРЕДИМСТВА НА АВТОМАТИЧНИЯ АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ М-200А

Индикатор за нивото на АН

Индикаторът за нивото на артериалното налягане е разположен по дължината на лявата част на дисплея. Класификацията съответства на диапазоните, описани в таблицата на раздел «Норми на артериално налягане». След измерване на АН, цветният пунктир светва в лявата част на дисплея: зелена зона - оптимално налягане, жълта - повишено, оранжева - много високо, червената - застрашаващо високо. Тази функция ще Ви позволи самостоятелно да се ориентирате за получените резултати от измерването.

Технология за откриване на нарушения в честотата на сърдечния ритъм (IHB)

Тази технология позволява да се определи неритмичното биене на сърцето. Ако на дисплея на уреда се появява символ на технологията IHB , това означава, че по време на измерването на артериалното налягане уредът е открил някакви нарушения в честотата на сърдечния ритъм.

Възможно е, в някои конкретни случаи, този резултат да се дължи на промяната на Вашето обично артериално налягане. Повторете измерването още веднъж. В повечето случаи няма причина за беспокойство. Ако, обаче, символът  се появява постоянно (например, няколко пъти седмично при ежедневно измерване), ние Ви препо-

ръчваме да съобщите това на лекаря си. Моля, покажете на лекаря следното обяснение:

Информация за медиците относно технологията за откриване на нарушения в честотата на сърдечния ритъм (ИНВ).

Даденият уред представлява осцилометричен уред за измерване на артериалното налягане с функция за анализ на честотата на пулса по време на измерването. След приключване на измерването, на дисплея на уреда се появява символът на технологията ИНВ , ако при измерването на артериалното налягане уредът е отчел никакви нарушения в честотата на пулса.

Ако символът  се появява достатъчно често (например, няколко пъти седмично при ежедневни измервания), се препоръчва да се проведе медицинско изследване. Този уред в никакъв случай не замества кардиологичното изследване, но позволява да се открият нарушения на честотата на сърдечните съкращения в ранен стадий.

ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА

Важна информация

1. Използвайте уреда САМО по предназначение, както е описано в тази инструкция.
2. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ аксесоари, непосочени от производителя.
3. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ уреда, ако той работи неточно или е повреден.
4. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ уреда на места, където има разпръснати аерозоли и на места, където става подаване на кислород.
5. В никакъв случай НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ уреда за новородени или малки деца.
6. Този уред НЕ Е средство за лечение на каквото и да е симптоми или заболявания. Резултатите от измерванията служат само за информация. Обърнете се към лекар за консултация.
7. ЗАБРАНЯВА СЕ съхраняването на уреда и гъвкавия кабел върху горещи повърхности.
8. НЕ ПОСТАВЯЙТЕ маншета върху други части на тялото, освен върху горната част на ръката.
9. ВАЖНО Е правилно да се използва и периодично да се правят проверки на уреда за удължаване срока му на работа. Ако не сте сигурни в точността на показанията на уреда, обърнете се към местния сервис.
10. Този уред е предназначен за ползване от лица над 18 години.

11. Не използвайте уреда за поставяне на диагноза хипертония и за измерване на артериалното налягане на новородени, малки деца или на лица, които не са дали съгласие за това.
12. Резултатите от измерванията, получени при използване на този уред, трябва да се тълкуват САМО от лекар, ако Ви е поставена диагноза аритмия или неравномерно сърдебиене, предсърдни или камерни екстрасистоли, предсърдно мъждане.

ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ НА УПОТРЕБА НА УРЕДА

Комплектоване

В комплекта влизат: автоматичен апарат за измерване на артериално налягане модел M-200A, маншет размер M (22-42 см), 4 батерии тип AA, мрежов адаптер, инструкция за експлоатация, гаранционна карта, опаковка.

Външен вид и описание на уреда

На картиката е показан автоматичен апарат за измерване на артериално налягане модел M-200A.



В комплекта влизат:



Инструкция



Маншет




Адаптер

* Използвайте само адаптер с търговска марка Dr. Frei.

Поставяне на батериите

1. Свалете капака на гнездото за батерии (виж рисунката).
2. Поставете батерийте, спазвайки поляритета.

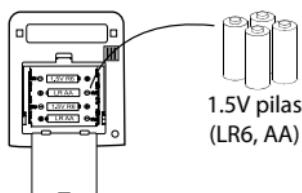

- Затворете защитния капак. Използвайте само оригинални батерии тип LR6, AA.

ВНИМАНИЕ


- Ако на дисплея се появява предупредителен символ  , значи батерите са практически изтощени. След появяване на предупредителния символ  , уредът няма да работи, докато не бъдат сменени батерите.
- Ако уредът не се използва дълго време, се препоръчва батерите да бъдат извадени.
- Препоръчва се използване на батерии тип AA (1,5 V). Не се препоръчва използване на акумулаторни батерии 1,2 V.
- За проверка на всички елементи на дисплея, задръжте натиснат бутон ON/OFF. При нормално функциониране на уреда, символите на всички елементи светват.

ЗАБЕЛЕЖКА: За икономия на батерите, уредът се изключва автоматично след една минута или с натискане на бутон Вкл./Изкл.

Въвеждане на дата/час


С функцията дата/час всяко измерване се записва в паметта на апарат с точна дата и час на провеждането на измерването.

- Натиснете бутона «», за да включите апаратата.
- Натиснете и задръжте бутона «» докато на екрана мига «Годината».
- След това с натискане на «M», изберете желаната стойност.
- По същият начин въведете месец, ден, час, минута.



ЗАБЕЛЕЖКА:

- Ако е необходимо да промените датата и часа, натиснете и задръжте бутона дата/час за 3 секунди докато цифрата на годината запоне да мига. След това въведете новите данни по начина описан по-горе.
- Всеки път, когато натискате бутоните «Памет» («M») и «Дата/час» («») - преминаване към следващия режим задаване или промяна на стойността с +1.
- Ако задържите бутона, можете да ускори прехода към желания режим, или превключване към правилното число.



година	месец	дата	часове	минути

Избор на потребител

Настоящият апарат за измерване на артериално налягане поддържа памет за запаметяване на 30 измервания за 2-ма потребителя. Преди да стартирате измерването, се убедете, че сте настроили апаратата за съответния потребител.

- Когато устройството е изключено, натиснете бутона «SET», в горния ляв ъгъл се покаже съответният символ на потребителя. 
- Натиснете бутона «SET» отново, за да превключите на желания потребител.
- Натиснете ON / OFF, за да потвърдите потребителя. 

Включване на мрежов адаптер

При автоматичният апарат за измерване на артериално налягане M-200A е предвидена възможност за работа с мрежов адаптер.

- Включете буксата на адаптера в гнездото, разположено в долната част на уреда. Захранването на уреда от батерийте автоматично се изключва.
- Включете адаптера към източник на захранване 220/110 V. Уредът е готов за работа.
- Проверете готовността за работа на уреда с натискане на бутона ON/OFF.




ЗАБЕЛЕЖКА:

- Използвайте само адаптер с търговска марка Dr. Frei. При използване на какъвто и да било друг адаптер, сервизът не носи отговорност за гаранционното обслужване на уреда.
- Батерийте не се изтощават, когато адаптерът за променлив ток е

- включен към уреда.
- Моля, обрънете се към сервис, ако имате въпроси, касаещи работата на устройството с променлив ток.

Включване на маншета

Включете конектора на маншета към гнездото, на левия панел на уреда, както е показано на рисунката.

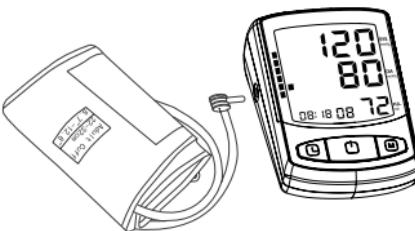

ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗМЕРВАНЕ


ВНИМАНИЕ

- Преди измерване е желателно известно време да поседите в отпуснато състояние
- Всяко физическо напрягане на пациента може да повиши артериалното налягане. Обрънете внимание на това тялото да бъде в покой, да няма напрежение на мускулите на ръката, на която ще се извършва измерването.
- Измервайте налягането винаги на една и съща ръка (обикновено лявата).
- Освободете лявата ръка от дрехите. НЕ запретвайте ръкава, защото той притиска ръката и това ще доведе до неточно измерване.
- Използвайте само оригинален маншет!
- Ако искате да следите своето артериално налягане, старайте се да правите измерванията по едно и също време, тъй като артериалното налягане се променя през денонощието.
- Ако искате да получавате коректни резултати, правете повторно измерване след 5 минутна почивка.

Поставяне на маншета

1. Съединете маншета с уреда, като поставите конектора на маншета в гнездото отляво на уреда.

2. Изпънете и поставете лявата (дясната) си ръка пред себе си с дланта нагоре. Закрепете маншета на ръката над лакътя. Маркерът за артерията в края на маншета трябва да е на 2 - 3 сантиметра над лакътната свивка от вътрешната страна на ръката.
3. Между маншета и ръката трябва да остава малко пространство, колкото да се пъхнат два пръста. Свалете дрехите, покриващи или притискащи ръката, на която ще се извърши измерването.
4. Закрепете маншета на едно ниво лепенката. Убедете се, че горният и долният край на маншета са разположени на едно ниво.




Процес на измерване

Винаги включвате уреда едва след поставяне на маншета.

1. Натиснете бутона «ON/OFF». Всички символи ще се появят на екрана за 2 секунди, след което ще се старира режим Измерване екрана ще се появи «0» или резултатът от последното измерване.



2. Маншетът автоматично ще се напомпа. Индикаторът «♥» ще мига на екрана. След измерването на екрана ще се появи резултатът от измерването.

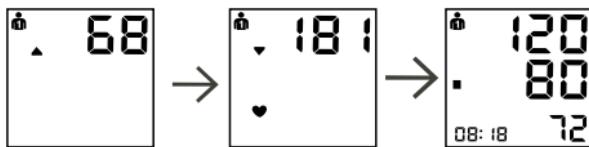

Разчитане на резултатите от измерването

След приключване на измерването на дисплея светват стойностите на артериалното налягане, пулса и нивото на артериалното налягане по скалата на Световната здравна организация. Появяването на

символа  означава, че уредът е отчел нарушение в нормалния сърдечен ритъм. Този индикатор служи за предупреждение.

ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчваме Ви да по-търсите консултация с лекар, ако този символ се появява често (3-5 пъти за седмица при ежедневни измервания). Не забравяйте, че по време на измерването, е важно да седите отпуснато, спокойно и да не разговаряте. На дисплея се появява скала, покаваща нивото на артериалното налягане по скалата на Световната здравна организация.



- Застрашаващо високо артериално налягане
- Високо артериално налягане (Хипертония II-ра степен)
- Високо артериално налягане (Хипертония I-ва степен)
- Повишено артериално налягане
- Нормално артериално налягане
- Оптимално артериално налягане

Прекъснати измервания

Ако по някаква причина трябва да прекъснете измерването натиснете бутона ON/OFF. Уредът автоматично ще изпусне налягането в маншета.



ФУНКЦИЯ «ПАМЕТ»

След приключване на измерването апаратът автоматично запаметява резултата с дата и час. Паметта на апаратът е предвидена за 30 измервания за двама потребителя.

Преглед на запазените стойности

Когато апаратът е изключен, натиснете бутона за Памет («M»). На дисплея се показва **Avg**, а след това - средната стойност от последните три измервания, направени в интервал от 10 минути. Забележка: Ако няма направени измервания за последните 10 минути, на дисплея ще се покаже «0»; ако за последните 10 минути има само едно измерване, апаратът ще покаже само тази последна стойност; ако за последните 10 минути има запаметени стойности от 2 измервания, апаратът ще покаже усреднената стойност от тях. В паметта се запазват измерванията и средната им стойност за всеки от двамата потребители. Ако искате да видите запаметените стойности се убедете, че сте превключили на правилния потребител.

При следващо натикане на бутона «M» на дисплея ще се покаже бутона «M» докато стигнете. За да видите конкретен резултат, натиснете бутона «M» докато стигнете до желания резултат. Ако апаратът е засякъл аритмия на дисплея се появява символът , заедно с резултата от измерването, датата и часа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не правете измервания непосредствено едно след друго тъй като това води до некоректни резултати. Почивайте в течение на няколко минути, в седнало или легнало положение, преди следващото измерване.

Изтриване на всички стойности

Преди изтриване на резултатите се убедете, че те няма да Ви потрябват в бъдеще. Ако е необходимо, запишете измерванията, в случай че се наложи да ги предоставите на своя лекар.

За да изтриете всички запазени стойности, натиснете и задръжте бутона «M», докато на дисплея започне да мига символът «**No**». Пуснете бутона, след което докато мига «**No**» натиснете отново бутона «M», за да завършите операцията. Не може да бъдат изтривани само отделни измервания.



ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Ако изпълнявате посочените по-долу действия, но грешката се появява отново или се появява грешка, която не е посочена в следващата таблица, се обърнете към сервиз. В никакъв случай не се опитвайте да ремонтирате уреда самостоятелно!

Съобщение на экрана	Възможна причина	Отстраняване
Когато натискате бутон ON/OFF на экрана нищо не се появява или се появява мигащ символ на изтощени батерии  .	Батериите не са поставени	Поставете батериите
	Батериите са изтощени	Сменете батериите с нови
	Нарушена е полярността на батериите	Поставете батериите, спазвайки полярността
E1 Няма нормално напомзване на маншета	Проверете маншета за херметичност	Заменете маншета с нов
E3 Уредът напомпва много високо налягане в маншета		Направете повторно измерване или занесете уреда в сервиз за проверка
E2 E4 Имало е движение на ръката по време на измерването	Ръката или тялото са се движили по време на измерването	Не се движете по време на измерването и направете повторно измерване
 Символ на батерията	Нисък заряд на батериите	Заменете батериите и повторете измерването

Показателят на систолично или диастолично налягане е много висок	Маншетът се намира под нивото на сърцето	Спазвайте правилното положение и повторете измерването
	Маншетът е поставен неправилно	
	Вие сте се движили или сте разговаряли по време на измерването	
Показателят на систолично или диастолично налягане е много нисък	Маншетът се намира над нивото на сърцето	
	Вие сте се движили или сте разговаряли по време на измерването	

ВНИМАНИЕ

Ако апаратът за измерване на артериалното налягане има проблем от техническо естество, моля свържете се със сервисния център или официалния представител на търговска марка Dr. Frei® във вашата страна. **В никакъв случай не опитвайте да поправяте уреда!** В случая на самостоятелно отваряне гаранция устройство се анулира.

ЗАБЕЛЕЖКА: Кръвното налягане има тенденция да се колебае през деня дори при здрави хора. Обърнете внимание на факта, че, за да могат да се сравнят резултатите от измерванията, тези измервания трябва да се извършват приблизително по същото време и при едни и същи условия (в покой)! Ако въпреки спазването на горните изисквания, колебанията на налягането, превишават 15 mm Hg и/или често се локализира аритмия, следва да се обърнете към лекар.

СЪХРАНЕНИЕ И ГРИЖА

Съхранявайте апарат за измерване на артериално налягане на сухо място, защитено от прекомерно високи/ниски температури, прах и пряка слънчева светлина.



Не усуквайте, извивайте или удряйте маншета, за да не повредите намирация се в него изключително чувствителен датчик.



За почистване на апаратът, използвайте чиста, мека кърпа. Не използвайте бензин, разтворител, или други подобни средства. Петна на маншета да се отстраняват внимателно с навлажнена със сапунен разтвор кърпа. Да не се пере маншетът!



Отнасяйте се внимателно с гумените тръбички. Пазете маншета и гуменияте тръбички от остри предмети.



Не изпускате апаратът и не използвайте сила при работа с него.



Никога не отваряйте устройството! Рискувате да нарушиТЕ фабричното калибиране.



ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИТЕ

СИМВОЛ	ОПИСАНИЕ
	Вижте инструкцията за ползване
	Производител
	Сериен номер
	Внимание, виж съпровождащите документи
	След окончателна употреба изхвърляйте в съответствие с изискванията във Вашата страна
	Оборудване тип BF
	Клас за защита II
	Маркировка CE

Периодично калибриране

Точността на прецизните измервателни апарати следва да бъде периодично проверявана. Ние препоръчваме периодично, веднъж на всеки две години, да проверявате точността на уреда. Повече информация може да получите от сервисния център.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод на измерване	Осцилометричен
Индикация	Цифров LCD дисплей
Диапазон на измерване:	Налягане: 30 - 280 мм жив. ст. Пулс: 40 - 199 уд/мин.
Точност на измерване:	Налягане: ± 3 мм жив.ст. Пулс: $\pm 5\%$

Памет:	30 резултата за двама потребители
Източник на захранване:	Батерии 4 x 1,5 V (LR6 или AA)
Диапазон на работна температура:	+5 - +40 °C, относителна влажност: 15% - 93%, атмосферно налягане: 70 kPa ~ 106 kPa
Условия на съхранение:	-20 - +55 °C, относителна влажност: 0% - 93%, атмосферно налягане: 50 kPa ~ 106 kPa
Размери на уреда:	135 (дължина) x 90 (ширина) x 62 (височина) mm
Тегло:	380 g без батерии
Размери на маншета	22 - 42 см
Класификация	Тип BF
Мрежов адаптер	Вход: 100 - 240 V, ~50/60 Hz, 0.2 A Изход: 6 V --- 500 mA

* Възможни са промени на техническите характеристики и дизайна на уреда с цел тяхното подобряване, без предварително уведомяване.

ГАРАНЦИЯ

За автоматичния апарат за измерване на артериално налягане модел М-200A действа гаранция със срок 5 години от деня на покупката. Гаранцията за маншета е 1 година от деня на покупката. Гаранцията не покрива повреди в резултат на неправилна експлоатация, нещастни случаи, неспазване на инструкциите за употреба или самостоятелни опити за отваряне и/или ремонт на апарат.

Гаранцията е валидна само само при представянето ѝ заедно с фактура/касова бележка, издадена от продавача, при условие, че е попълнена четливо и съдържа, без изключение, всеки един от изброените реквизити: печат на продавача, модел, сериен номер, дата на покупката и подпис на купувача.

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in metres (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

■ Shenzhen Pango Electronic Co., Ltd., No. 25 1st Industry Zone, Fenghuang Rd.,
Xikeng Village, Henggang Town, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province,
China.   Lotus NL B.V., Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague,
Netherlands.

global-swiss.ch
dr-frei.com



CE ISO
0413 13485

